



Nasz znak EZP/06/20

Poznań, dnia .02. 2020 roku

### Szanowni Wykonawcy !

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -obłożenia operacyjne dla wszystkich jednostek szpitala - 49 pakietów.**

**I. Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) w sposób jak poniżej :**

**1. Zmiana polega na dopisaniu do § 5 ust.2-3 słowa o brzmieniu „roboczych”**

**Po zmianach § 5 otrzymuje brzmienie :**

#### § 5

1. Termin dostawy przez Wykonawcę ustalony w § 3 może zostać przedłużony zgodnie z § 6 ust.1.
2. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust.1 Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni **roboczych** od dnia zaistnienia powyższych przyczyn, wyznaczając nowy termin dostawy.
3. W przypadku możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 2 dni **roboczych** celem uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.

**2.Zmiana polega na zastąpieniu w § 13 ust.1 pkt.a) wyrażenia: „10% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1” na „10% niezrealizowanej wartości umowy”**

**Po zmianach § 13 otrzymuje brzmienie :**

#### § 13

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjne na rzecz Zamawiającego w wysokości:
  - a) **10% niezrealizowanej wartości umowy** , w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
  - b) 0,2% wartości niewykonanego lub nienależyte wykonane zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia,
  - c) 0,2% wartości nienależyte wykonane zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy.
- 2 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar wymienionych w ust. 1.
- 3.Zamawiający może potrącać kary wymienione w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zmiana polega na dopisaniu do „Przedmiotu zamówienia”:  
pkt.24 – słów o brzmieniu „lub równoważny rozmiar „L””

pkt.32 słów o brzmieniu „lub zamiennie pęseta do ILM -1 szt. Zamawiający  
zdecyduje w zamówieniu o zakupie nożyczek lub pęsety”

**PAKIET 42**

**Wadium: 6.815,00 zł**

Ip.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP)	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzspółnotowy m nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
1.	Zestaw 23G, zestaw z kasetą do aparatu Constellation do witrektomii w (posiadaniu Zamawiającego) , w składzie: 1.kaseta Venturii kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt. 2.pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt. 3.oświetlacz prosty std 23G – 1 szt. 4.linia ekstruzyjna – 1 szt. 5.zestaw trokarów 23G – 3 szt. 6.kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt. 7.worek odpływowy – 1 szt. 8.3-drożny zawór odcinający – 1 szt. 9.zestaw do kroplówki – 1 szt. 10.strzykawka 20 ml – 1 szt. 11.igła z końcówką silikonową 23G typu Soft Tip – 1 szt. 12.obłożenie na stolik 140x140 – 2 szt. 13.serweta do rąk – 3 szt. 14.mikrogałki – 1 szt. 15.kubeczek 60 ml – 1 szt. 16.kubeczek 120 ml – 1 szt. 17.strzykawka 10 ml – 1 szt. 18.strzykawka 2 ml – 2 szt. 19.strzykawka 5 ml – 2 szt. 20.osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 21.ocznik – 1 szt. 22.plastry – 1 szt. 23.fartuch, rozmiar L – 2 szt. 24.fartuch, rozmiar M <b>lub równoważny rozmiar „L”</b> – w części wierzchniej – 1 szt. 25.sączki – 1 szt. 26.obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt. 27.waciki 5x5 – 10 szt. 28.igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.	400						

silikonowego – 1 szt. 30.oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt. 31.kaniula do polewania 27G – 3 szt. 32.nożyczki jednorazowego użytku 25G – <b>lub zamiennie pęseta do ILM -          1 szt.</b> <b>Zamawiający zdecyduje w          zamówieniu o zakupie          nożyczek lub pęsety</b> 33.podłokietniki – 2 szt. 34. sonda do endolaseru 23G zakrzywiona – 1 szt.							
---	--	--	--	--	--	--	--

W załączeniu do odpowiedzi obowiązujący Pakiet nr 42.

4. Zmiana polega na dopisaniu do „Przedmiotu zamówienia” :  
 w pakiecie nr 43 pkt. 28 słów o brzmieniu „lub równoważny rozmiar „L””  
 w pakiecie nr 44 i 45 pkt. 24 słów o brzmieniu „lub równoważny rozmiar „L””

### PAKIET 43

Wadium: 7.225,00 zł

Ip.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP)	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzspółnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
1.	Zestaw 23G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego) do fakovitrektomii 23, w składzie: 1.kaseta Venturii kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt. 2.pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt. 3.oświetlacz prosty std 23G – 1 szt. 4.oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt. 5.linia ekstruzyjna – 1 szt. 6.zestaw trokarów 23G – 1 szt. 7.kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt. 8.worek odpływowy – 1 szt. 9.3-drożny zawór odcinający – 1 szt. 10.zestaw do kroplówki – 1 szt. 11.osłona Mayo (tacy narzędziowej) – 1 szt. 12.zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) – 1szt. 13.strzykawka 20 ml – 1 szt.	400						

<p>14. Tip skośny 30' 0,9 mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.</p> <p>15. igła z końcówką silikonową 23G typu Soft Tip – 1 szt.</p> <p>16. obłożenie na stolik 140x140 – 2 szt.</p> <p>17. serweta do rąk – 3 szt.</p> <p>18. mikrogąbki – 1 szt.</p> <p>19. kubeczek 60 ml – 1 szt.</p> <p>20. kubeczek 120 ml – 1 szt.</p> <p>21. strzykawka 10 ml – 1 szt.</p> <p>22. strzykawka 2 ml – 2 szt.</p> <p>23. strzykawka 5 ml – 2 szt.</p> <p>24. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.</p> <p>25. ocznik – 1 szt.</p> <p>26. plastry – 1 szt.</p> <p>27. fartuch, rozmiar L – 2 szt.</p> <p>28. fartuch, rozmiar M <b>lub równoważny rozmiar „L”</b> w części wierzchniej – 1 szt.</p> <p>29. sączki – 1 szt.</p> <p>30. obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i torebką – 1 szt.</p> <p>31. waciki 5x5 – 10 szt.</p> <p>32. igła 30G (2x igła zagięta, 1x igła prosta) – 3 szt.</p> <p>33. zestaw do podawania oleju silikonowego – 1 szt.</p> <p>34. nóż zakrzywiony w systemie slit 2,6 mm bevelup – 1 szt.</p> <p>35. nóż skośny 15' – 1 szt.</p> <p>36. nóż typu crescent 2,6mm – 1 szt.</p> <p>37. oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.</p> <p>38. kaniula do hydrodysekcji spłaszczona 27G – 3 szt.</p> <p>39. kaniula cystotom irygacyjny 27G – 1 szt.</p> <p>40. pęseta jednorazowego użytku do usuwania błon ILM – 1 szt.</p> <p>41. podłokietniki – 2 szt.</p> <p>42. sonda do endolaseru 23G zakrzywiona – 1 szt.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**W załączeniu do odpowiedzi obowiązujący Pakiet nr 43.**

**PAKIET 44**  
**Wadium: 7.225,00 zł**

Ip.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP)	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzspółnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
1.	<p>Zestaw 25+G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego) do fakowitrektomii 25+G, w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.kaseta kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt.</li> <li>2.pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.</li> <li>3.oświetlacz prosty std 25+G – 1 szt.</li> <li>4.linia ekstruzyjna – 1 szt.</li> <li>5.zestaw trokarów 25G – 3szt.</li> <li>6.kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.</li> <li>7.worek odpływowy – 1 szt.</li> <li>8.3-drożny zawór odcinający – 1 szt.</li> <li>9.zestaw do kroplówki – 1 szt.</li> <li>10.strzykawka 20 ml – 1 szt.</li> <li>11.igła z końcówką silikonową 25G typu Soft Tip – 1 szt.</li> <li>12.obłożenie na stolik 140x140 – 2 szt.</li> <li>13.serweta do rąk – 3 szt.</li> <li>14.mikrogąbki – 1 szt.</li> <li>15.kubeczek 60 ml – 1 szt.</li> <li>16.kubeczek 120 ml – 1 szt.</li> <li>17.strzykawka 10 ml – 1 szt.</li> <li>18.strzykawka 2 ml – 2 szt.</li> <li>19.strzykawka 5 ml – 2 szt.</li> <li>20.osłonka plastikowa na oko – 1 szt.</li> <li>21.ocznik – 1 szt.</li> <li>22.plastry – 1 szt.</li> <li>23.fartuch, rozmiar L – 2 szt.</li> <li>24.fartuch, rozmiar M <b>lub równoważny rozmiar „L”</b> w części wierzchniej – 1 szt.</li> <li>25.sączki – 1 szt.</li> <li>26.obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.</li> <li>27.waciki 5x5cm – 10 szt.</li> <li>28.igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.</li> </ol>	400						

<p>29.kaniula do polewania 27G – 3 szt.</p> <p>30.zestaw do podawania oleju silikonowego – 1 szt.</p> <p>31.pęseta do ILM jednorazowego użytku 25+ – 1 szt.</p> <p>32.podłokietniki – 2 szt.</p> <p>33.nóż zakrzywiony typu slit 2,6mm bevelup – 1 szt.</p> <p>34.nóż skośny 15' – 1 szt.</p> <p>35.nóż typu crescent 2,6mm – 1 szt.</p> <p>36.Tip skośny 30'0,9mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.</p> <p>37.sonda do endolaseru 25G zakrzywiona – 1 szt.</p> <p>38. Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia , o którym mowa w zapytaniu oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

W załączeniu do odpowiedzi obowiązujący Pakiet nr 44.

#### PAKIET 45

Wadium: 7.225,00 zł

Ip.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP)	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzspółnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
1.	<p>Zestaw 27+G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego) do fakovitrektomii 27+G, w składzie:</p> <p>1.kaseta kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt.</p> <p>2.pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.</p> <p>3.oświetlacz prosty std 27+G – 1 szt.</p> <p>4.linia ekstruzyjna – 1 szt.</p> <p>5.zestaw trokarów 27G – 3szt.</p> <p>6.kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.</p> <p>7.worek odpływowy – 1 szt.</p> <p>8.3-drożny zawór odcinający – 1 szt.</p> <p>9.zestaw do kroplówki – 1 szt.</p> <p>10.strzykawka 20 ml – 1 szt.</p>	300						

<p>10.strzykawka 20 ml – 1 szt.</p> <p>11.igła z końcówką silikonową 27G typu Soft Tip – 1 szt.</p> <p>12.obłożenie na stolik 140x140 – 2 szt.</p> <p>13.serweta do rąk – 3 szt.</p> <p>14.mikrogąbki – 1 szt.</p> <p>15.kubeczek 60 ml – 1 szt.</p> <p>16.kubeczek 120 ml – 1 szt.</p> <p>17.strzykawka 10 ml – 1 szt.</p> <p>18.strzykawka 2 ml – 2 szt.</p> <p>19.strzykawka 5 ml – 2 szt.</p> <p>20.osłonka plastikowa na oko – 1 szt.</p> <p>21.ocznik – 1 szt.</p> <p>22.plastry – 1 szt.</p> <p>23.fartuch, rozmiar L – 2 szt.</p> <p>24.fartuch, rozmiar M <b>lub równoważny rozmiar „L”</b></p> <p>– w części wierzchniej – 1 szt.</p> <p>25.sączki – 1 szt.</p> <p>26.obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.</p> <p>27.waciki 5x5 – 10szt.</p> <p>28.igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.</p> <p>29.kaniula do polewania 27G – 3 szt.</p> <p>30.pęseta do ILM jednorazowego użytku 27+ – 1 szt.</p> <p>31.podłokietniki – 2szt.</p> <p>32.nóż zakrzywiony typu slit 2,6mm bevelup – 1 szt.</p> <p>33.nóż skośny 15' – 1 szt.</p> <p>34.nóż typu crescent 2,6mm – 1 szt.</p> <p>35.Tip skośny 30'0,9mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.</p> <p>36.sonda do endolaseru 27G zakrzywiona – 1 szt.</p> <p>37.oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

W załączeniu do odpowiedzi obowiązujący Pakiet nr 44.45 2

II. Ponadto ,informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. zapisów SIWZ i § 7 wzoru umowy w zakresie pakietu nr 42-45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności w zakresie wyrobów medycznych zawartych w pakiecie nr 42-45 z 12 miesięcy do ¾ ich nominalnego terminu ważności.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 42( Zestaw 23G)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie, jak do tej pory, Zestawu 23G wymiennie z pęsetą ILM a nożyczkami (pół roku pęseta, pół roku nożyczki) ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I. pkt.3

**Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 42 – 45**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 42, 43,44 i 45 zamiast „fartuch, rozmiar M – w części wierzchniej – 1 szt.” Fartuch, rozmiar L – w części wierzchniej – 1 szt, tak jak to jest obecnie?

**Odpowiedź**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I. pkt.4

**Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy załącznik nr 8**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie również akceptował faktury w wersji papierowej.

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy załącznik nr 8**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Ilość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niezależnie od okoliczności w każdym przypadku Zamawiający zobowiązuje się zamówić towar o wartości wynoszącej minimum 80% wartości określonej w umowie i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 6 dot. wzoru umowy załącznik nr 8**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §5 ust. 2-3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„2. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust. 1 Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni **roboczych** od dnia zaistnienia powyższych przyczyn, wyznaczając nowy termin dostawy.

3. W przypadku możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 2 dni **roboczych**, celem uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1.

**Pytanie nr 7 dot. wzoru umowy załącznik nr 8**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 1 lit. d) projektu umowy w następującym brzmieniu:

„dopuszczalne jest skrócenie umowy, w przypadku zrealizowania pełnej wartości umowy przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 8 dot. wzoru umowy załącznik nr 8**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej umowy, przy czym Wykonawca nie ma obowiązku udzielenia upustów;
- b) zmiany spowodowane wzrostem lub zmniejszeniem stawki podatku VAT; w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto, cena netto pozostaje bez



zmian; cena brutto ulega zmianie z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT, bez konieczności zawarcia przez Strony aneksu do umowy;

- c) zgodnie z np. 142 ust. 5 pzp (umowa zawarta na okres powyżej 12 miesięcy) – zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
- 1) stawki podatku od towarów i usług (jak w lit. b)
  - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9 dot. wzoru umowy załącznik nr 8**

Zwracam się z prośbą o wykreślenie treści §6 ust. 4 projektu umowy.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 10 dot. wzoru umowy załącznik nr 8**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu.”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 11 wzoru umowy załącznik nr 8**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §8 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do dołączenia wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 do faktury VAT.”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 12 dot. wzoru umowy załącznik nr 8**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §13 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

- a) 10% kwoty wartości netto niezrealizowanej części umowy wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy;
- b) 0,2% wartości netto niewykonanego lub nienależyście wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 5% wartości netto tego zamówienia;
- c) 0,2% wartości netto nienależyście wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez zwłokę, za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 5% wartości netto nienależyście wykonanego zamówienia; kara umowna może zostać naliczona wyłącznie w przypadku, gdy nienależyte wykonanie zamówienia wynika z okoliczności zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę.”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 13 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 1 pkt 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„szczególne kategorie danych określone w art. 9 ust. 1 RODO tj. ....”

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:  
„Przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych”

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 15 dot. pakiet nr 41**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie całkowicie oddychających czepków z włókniny wiskozowej, bez wstawki chłonnej?

**Z Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 16 dot. pakiet nr 4 poz.1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety głównej o wymiarach 230x400cm, wyposażonej w otwory o wymiarach całkowitych 16x16cm i otworem cięcia 12,5cm? Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 17 dot. pakiet nr 32 poz.1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety głównej wyposażonej w otwory do dościa udowego o wymiarach całkowitych 16x16cm i otworem cięcia 12,5cm? Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 18 dot. pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm, wykonanej z włókniny o gramaturze min. 27g/m<sup>2</sup> i folii PE min. 55 μm? Absorpcja zgodna z wymaganiami normy EN ISO 9073-6.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 19 dot. pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 38 x 40 cm?

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 20 dot. pakiet nr 16**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z taśmą samoprzylepną 9 x 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 21 dot. pakiet nr 39**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro powyżej 149/125 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22 dot. pakiet nr 25**

Czy zamawiający dopuści zestaw do procedur koronarografii i koronaroplastyki o składzie:

1. Obłożenie pacjenta z 4 otworami na tt. Udowe oraz tt. Promieniowe zintegrowane tworząc jedno obłożenie o wymiarach 240x330cm, ze wzmocnieniem o wymiarach 75x240cm oraz otworami 2x

- 5x7cm i 2x 7x9cm, warstwa przezroczysta po obu stronach o wymiarach 220x70cm, obłożenie o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> oraz folii PE 40 mikronów. – 1szt
2. Serweta 75x90cm – 1szt
  3. Osłona na stół instrumentalny o wymiarach 150x150cm – 1szt
  4. Serweta wysokochłonna o wymiarach 34x50cm z paskiem samoprzylepnym – 1szt
  5. Osłona na aparaturę 90x70cm – 1szt
  6. Osłona na aparaturę typu czepek o średnicy 90cm – 1szt
  7. Miska nerka 700ml – 1szt
  8. Miska 2500ml jak w swiz – 1szt
  9. Skalpel 11 – 1szt
  10. Lizak do mycia pola – 2szt
  11. Kleszcze metalowe proste – 1szt
  12. Fartuch SMS rozm. L – 2szt
  13. Strzykawka 5ml L/L – 1szt
  14. Strzykawka 10ml L/L – 1szt
  15. Strzykawka 10ml L/L z czerw. – 1szt
  16. Strzykawka 20ml L/L- 1szt
  17. Strzykawka angiograficzna 12ml – 1szt
  18. Kompres 7.5x7.5cm 8-warst – 20szt
  19. Serweta pod rękę pacjenta 45x75cm – 1sz
  20. Taśma lepna – 1szt.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 23 dot. pakiet nr 30 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne nieprzezroczyste wykonane z włókniny SMS, gramatura 35 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24 dot. pakiet nr 40**

Czy zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszkliskowych z serwetą SMS w pozycji 1 - o wymiarach 45x75cm z otworem o średnicy 8cm oraz folią 10x14cm, reszta komponentów zgodnie z SWIZ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 25 dot. pakiet nr 5 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną, osłona złożona teleskopowo co ułatwia czyste nakrycie stolika, serweta w rozmiarze 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 60 x 145 cm, osłona wykonana z włókniny o gramaturze łącznej min. 90 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 26 dot. pakiet nr 6 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej, o wymiarach 90 x 100 cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu włókniny polipropylenowej (min. 30 g/m<sup>2</sup>) i folii polietylenowej (min. 25 g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 27 dot. pakiet nr 7 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej, o wymiarach 75 x 90 cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu włókniny polipropylenowej (min. 30 g/m<sup>2</sup>) i folii polietylenowej (min. 25 g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 28 dot. pakiet nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 38 x 43 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 29 dot. pakiet nr 39 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej pełnoochronnego fartucha chirurgicznego zapinanego u góry na taśmę samoprzylepną wielorazowego użytku pozwalającą na indywidualne dopasowanie rozmiaru dekoltu fartucha, wykonanego z włókniny o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 139/138 kPa – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 30 dot. pakiet nr 41 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m<sup>2</sup> - pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 31 dot. pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny wzmocniony, skład zestawu:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną (15x50cm) w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym 240x150cm – 1 szt.
2. serwety boczne z taśmą lepnią z dodatkową warstwą chłonną (15x50cm) w strefie krytycznej i organizatorami przewodów 90x75cm – 2 szt.
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną (15x50cm) w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym 180x180cm – 1 szt.
4. taśma samoprzylepna o wym 9x50cm – 1 szt.
5. ręczniki chłonne o wym 30,5x34cm – 4 szt.
6. osłona na stolik Mayo o wym 79x145cm – 1 szt.
7. serweta na stolik – (owinięcie zestawu) o wym 150x 190cm – 1 szt.
8. Wymagania: serwety operacyjne wykonane z włókien barierowych, laminowanych, 3-warstwowych w obszarze krytycznym wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na sucho w strefie krytycznej 168kPa Wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na mokro 168kPa, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, chłonność strefy krytycznej 563 ml/m<sup>2</sup>. Serwety wykonane z lamiantu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa 30g/m<sup>2</sup>, folia polietylenowa 33µm (30g/m<sup>2</sup>)) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> + dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura w części 140g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 32 dot. pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw uniwersalny wzmocniony, skład zestawu:

9. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną (25x60cm) w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym 240x150cm – 1 szt.
10. serwety boczne z taśmą lepnią z dodatkową warstwą chłonną (25x60cm) w strefie krytycznej i organizatorami przewodów 90x 75cm – 2 szt.
11. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną (25x60cm) w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym 180x180cm – 1 szt.
12. taśma samoprzylepna o wym 9x50cm – 1 szt.
13. ręczniki chłonne o wym 30,5x34cm – 4 szt.
14. osłona na stolik Mayo o wym 79x145cm – 1 szt.
15. serweta na stolik – (owinięcie zestawu) o wym 150x 190cm – 1 szt.
16. Wymagania: serwety operacyjne wykonane z włókien barierowych, laminowanych, 4-warstwowych w obszarze krytycznym wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na sucho w strefie krytycznej 314kPa Wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na mokro 290kPa, odporność na przenikanie cieczy 167cm H<sub>2</sub>O, chłonność strefy krytycznej 563 ml/m<sup>2</sup>. Serwety wykonane z lamiantu trzywarstwowego

(włóknina polipropylenowa (30g/m<sup>2</sup>), folia polietylenowa 33µm (30g/m<sup>2</sup>), włóknina polipropylenowa (15g/m<sup>2</sup>)) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> + dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura w części 155g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 33 dot. pakiet nr 3**

Zgodnie z zapisem zawartym części I.2.B SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż podane przez Zamawiającego parametry i wymiary są minimalnymi, jakich Zamawiający będzie wymagał.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 34 dot. pakiet nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 osłony na stół Mayo 79x145cm, wykonanej z mocnej folii PE 60µm o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną 65x85cm, wykonaną z laminatu PE+PP o gramaturze 85g/m<sup>2</sup> (całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>), chłonność 563ml/m<sup>2</sup>. Osłona składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 35 dot. pakiet nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 serwety wykonanej z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa (30g/m<sup>2</sup>), folia polietylenowa 33µm (30g/m<sup>2</sup>), włóknina polipropylenowa (15g/m<sup>2</sup>)) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 36 dot. pakiet nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 jałowej serwety 75x80cm z czterema taśmami przyklepnymi w rogach serwet oraz otworem owalnym przyklepnym o wymiarach 6x15cm, umieszczonym centralnie, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 37 dot. pakiet nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 kieszeni o wymiarach 40x30cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 38 dot. pakiet nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 niżej opisanego zestawu?

1. 1 x Serweta podfoliowana 90x120cm (stanowiąca owinięcie zestawu)
2. 1 x Osłona na stół Mayo 78x145cm wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z laminatu PE+PP o gramaturze 85g/m<sup>2</sup> (całkowita gramatura w 140g/m<sup>2</sup>)
3. 2 x Serweta 75x90cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>
4. 1 x Serweta 90x120cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>
5. obłożenie okulistyczne 120x160cm wykonane z włókniny typu SMS z otworem 10x10cm wypełnionym folią chirurgiczną (zabezpieczoną papierem). Serweta zintegrowana z 2 kieszeniami 25x26cm (usytuowanymi po obu stronach otworu), poniżej otworu umieszczony sztywnik i taśma samoprzylepna 5x50cm.
6. 5 x Tufery gazowe 20/19cm
7. 5 x kompresy gazowe 5x5cm
8. 1 x kompres oczny włókninowy, owalny 7 x 5,4cm
9. 1 x patyczek z bawełnianą końcówką
10. 2 x osłona na podłokietnik 30x75cm
11. 1 x fartuch operacyjny STANDARD wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów 40 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho/mokro 200/200kPa, rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 6cm, rozmiar L

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 39 dot. pakiet nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 niżej opisanego zestawu? Sterylny zestaw uniwersalny, zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych:

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm – 1 szt.
2. ręczniki do rak 30,5x34cm – 4 szt.
3. serweta na stolik Mayo 79x145cm – 1 szt.
4. taśma samoprzylepna 9x50cm – 1 szt.
5. serwety operacyjne samoprzylepne wzmocnione 75x90cm z organizatorami przewodów – 2 szt.
6. serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 180x180cm z paskiem lepny 100cm i organizatorami przewodów – 1 szt.
7. serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 150x240cm z paskiem lepny 100cm i organizatorami przewodów – 1 szt.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej). Gramatura laminatu podstawowego 60g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 15x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 140 g/m<sup>2</sup>. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego warstwy laminatu połączone trwale, materiał obłożenia spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych

zestaw sterylny (metoda sterylizacji – tlenek etylenu), jednorazowego użytku.

Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 40 dot. pakiet nr 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 niżej opisanego zestawu?

1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu – 1 szt
2. Serweta do stentów 220x320cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm, wypełnionymi folią operacyjną PU. Z dodatkową łątą chłonną 100x150cm. Serweta z panelem foliowym (PE) obustronnym 60x320cm każdy – 1 szt
3. Serweta włókninowa barierowa 75x90cm z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm – 4szt
4. Kieszeń przylepna jednokomorowa 30x40cm – 1szt
5. Osłona foliowa na lampę i ekran typu czapeczka, ściągnięta elastyczną gumką Ø140cm – 2 szt
6. Osłona foliowa na lampę i ekran typu czapeczka, ściągnięta elastyczną gumką Ø90cm – 1 szt
7. Miska medyczna plastikowa przezroczysta o pojemności 120 ml – 1 szt
8. Miska medyczna plastikowa niebieska o pojemności 250 ml – 2 szt
9. Kleszczyki plastikowe opatrunkowe o długości 19cm, jednorazowego użytku – 1 szt
10. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace, wzmocniony z przodu i na rękawach, rozmiar XL – 2szt
11. Ręcznik włókninowy do rak 20x40cm – 20 szt.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 41 dot. sposobu pakowania asortymentu jałowego**

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 2017/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert

uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie ?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia , o którym mowa w zapytaniu.

**Pytanie nr 42 dot. opisu przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta wymaga, aby serwety wchodzące w skład zestawów obłożeń, mające kontakt z pacjentem nie zawierały pyłących włókien wiskozy i celulozy?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia , o którym mowa w zapytaniu.

**Pytanie nr 43 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 28 g/m<sup>2</sup>, folia PE 25 mq

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 44 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 serweta na stolik wzmocniona na całej powierzchni 150x190cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m<sup>2</sup> służąca jako owinięcie zestawu,

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 45 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 fartuchy wykonane z włókniny bawełnopodobnej w systemie Spunlace włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura min.68g/m<sup>2</sup>, wstawka z przodu i na rękawach nieprzemakalnym laminatem PP/PE min 28 g/m<sup>2</sup> ; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min 211/200kPa, nieprzemakalność min 134 mm H<sub>2</sub>O , rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 46 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 osłona na stolik Mayo 79x145cm (dopuszczalny wymiar +10%) z warstwą chłonną min. 60x85cm, włóknina wiskozowa 36 g/m<sup>2</sup>, folia PE min. 0,07 mm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 47 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 ręcznik min.34x50cm ,wysoko chłonny, włókninowy

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 48 dot. Pakiet nr 1 poz1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 serweta włókninowa min.30x30 cm, 17 nitkowa, 4 warstwowa, RTG

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 49 dot. pakiet nr 1 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 serweta gazowa 45x45cm 17Th 4P RTG

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 50 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 nerka min. 700ml polipropylenowa niebieska

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 51 dot. pakiet nr 1 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 kieszeń samoprzylepna min. 40x30cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 52 dot. pakiet nr 1 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 organizator przewodów – taśma rzep w systemie velcro min. 2,5x22cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 53 dot. pakiet nr 1 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 opatrunek oddychający, włókninowy, min. 9x30cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 54 dot. pakiet nr 1 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 serweta z taśmą lepna, barierowa min. 75x75cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 55 dot. pakiet nr 1 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 taśma lepna 9x49cm (dopuszczalny wymiar +10%), wykonana z włókniny wodnoigłowanej min. 40g/m<sup>2</sup> min. 48 % poliester oraz min. 50 % celuloza.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 56 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 serweta 90x75cm, wykończona w centralnej po bokach standardowa taśma lepna, serweta posiada dodatkową wstawkę wysoko chłonną gramatura min 50g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej, rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny min.50 g/m<sup>2</sup> łąta chłonna . Laminat podstawowy wykonany z włókniny PP min 30 g/m<sup>2</sup>, folii PE min. 30 gr/m<sup>2</sup> , odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 150/150 kPa

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 57 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 serweta 175x175cm, wykończona w centralnej części przezroczystą standardową taśmą lepna, rozmiar min. 3x40cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysoko chłonną gramatura min 50g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m<sup>2</sup> łąta chłonna, włókniny min. 30 g/m<sup>2</sup>, folii PE min. 30 gr/m<sup>2</sup> , odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 150/150 kPa

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 58 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 serweta z elastyczną folią 300x175cm, wykończona w centralnej części przezroczystą standardową taśmą lepna , rozmiar min 3x40cm, po bokach standardowa taśma lepna .Serweta posiada dodatkową wstawkę wysoko chłonną gramatura min 50g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m<sup>2</sup> łąta chłonna, włókniny min.30 g/m<sup>2</sup>, folii PE – min. 30 gr/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min.150/150 kPa



**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 59 dot. pakiet nr 1 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 folia chirurgiczna min.44x80cm.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 60 dot. pakiet nr 1,2 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1,2 pozycja 1 zestaw do odsysania Yankauer 22CH, długość drenu 210 cm.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 61 dot. pakiet nr 3 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 3, pozycja 1 zestaw o składzie :

Zestaw uniwersalny wzmocniony, skład zestawu:

17. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym 240x150cm – 1 szt.
18. serwety boczne z taśmą lepłą z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x 75cm – 2 szt.
19. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym min. 150x200cm – 1 szt.
20. taśma samoprzylepna o wym min.9x49cm – 1 szt.
21. ręczniki chłonne o wym min.18x25cm – 4 szt.
22. osłona na stół Mayo o wym min.79x140cm – 1 szt.
23. serweta na stół – (owinięcie zestawu) o wym 150x 190cm – 1 szt.

Wymagania: serwety operacyjne wykonane z włókien barierowych, laminowanych, 4-warstwowych w obszarze krytycznym wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min 166kPa Wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na mokro min 158kPa, odporność na przenikanie cieczy powyżej min.200cm H<sub>2</sub>O, gramatura strefy krytycznej i wzmocnienie min 50g/m<sup>2</sup>, włóknina min. 28g/m<sup>2</sup>, folia PE min. 24 g/m<sup>2</sup>,

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 62 dot. pakiet nr 4 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4, pozycja 1 osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach min.100x50cm

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 63 dot. pakiet nr 4 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4, pozycja 1 osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach min.90x80cm

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 64 dot. pakiet nr 4 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4, pozycja 1, podpunkt 15 serweta absorpcyjna o wymiarach min.40x48cm złożona z min.6 warstw wysoko absorpcyjnej laminatu o gramaturze min.60 g/m<sup>2</sup> wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 65 dot. pakiet nr 4 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4, pozycja 1 , podpunkt 19 serweta operacyjna, laminat 2 lub 3 warstwowy min 56 g/m<sup>2</sup> (jedną z warstw stanowi folia PE), wymiary 75x90cm z otworem samoprzylepnym 8x15cm lub 8x12 cm pakowana w oddzielnie.

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.



**Pytanie nr 66 dot. pakiet nr 4 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4, pozycja 1 , podpunkt 20 serweta operacyjna do zabiegów endowaskularnych o wymiarach 223x400cm, wyposażona w dwa otwory do dojścia udowego o wymiarach 15x15cm, otoczony elastyczną membraną umożliwiającą szczelne dopasowanie obłożenia Serweta wyposażona jest w warstwę chłonną o wymiarach 100x250cm, oraz folię ochronną po obu stronach umożliwiającą łatwe dojście do paneli sterowniczych stołu operacyjnego

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 67 dot. pakiet nr 4**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4 wymagań:

- o Materiał bazowy serwety głównej to chłonny laminat dwuwarstwowy o gramaturze min.56g/m<sup>2</sup> (jedną z warstw stanowi folia PE)
- o odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) >390cm H<sub>2</sub>O według PN EN 20811
- o wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro (strefa krytyczna) min. 160/123 kPa według PN EN ISO 13938-1
- o Wyrób musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
- o Opakowanie jednostkowe folia/ Tyvek pozwalające na otwarcie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki
- o Odporność na penetrację płynów min. 960 cmH<sub>2</sub>O

Opakowanie posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim Ułożenie poszczególnych komponentów pozwala na szybkie i bezpieczne przygotowanie do zabiegu

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 68 dot. pakiet nr 14 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 14, punkt 1 serweta wzmocniona na stolik 150x190 – 200cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z 2- warstwowego laminatu wzmocnionego na całej powierzchni o gramaturze min. 59 g/m<sup>2</sup> wykonana z włókniny 24-30 g/m<sup>2</sup>, folia PE 28,5- 30 gr/m<sup>2</sup>, poziom absorpcji [900-981cm H<sub>2</sub>O]

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 69 dot. pakiet nr 14 poz.2**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 14, punkt 2 osłona na stolik Mayo z warstwą chłonną min.60x85cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 70 dot. pakiet nr 14 poz.10 , pakiet nr 15 poz.9**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 14 punkt 10 i w pakiecie 15 punkt 9 Serweta 2 warstwowa min.90x150 cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 71 dot. pakiet nr 15 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, punkt 1 serweta wzmocniona na stolik 150x190 – 200cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z 2- warstwowego laminatu wzmocnionego na całej powierzchni o gramaturze min. 59 g/m<sup>2</sup> wykonana z włókniny 24-30 g/m<sup>2</sup>, folia PE 28,5- 30 gr/m<sup>2</sup>, poziom absorpcji [900-981cm H<sub>2</sub>O]

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 72 dot. pakiet nr 15 poz.2**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, punkt 2 Osłona na stolik Mayo min.80x140cm z warstwą chłonną min.60x85cm, włóknina wiskozowa min.27 g/m<sup>2</sup>, Folia PE min.60 μm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 73 dot. pakiet nr 15 poz.3**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, punkt 3 ręcznik chłonny min. 18x25cm, celulozowo-poliestrowy

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 74 dot. pakiet nr 15 poz.4,5**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, punkt 4,5 fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min.(sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref min. 115 N. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej min.115 kPa, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm;

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 75 dot. pakiet nr 15 poz.6**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, punkt 6 Serweta z taśmą lepna, barierowa 90x75 cm, wykonana z włókniny min.28g/m<sup>2</sup> oraz filmu PE barierowego min. 28 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów na sucho/morko min.78/50 kPa, absorpcja min. 980 cm H<sub>2</sub>O).

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 76 dot. pakiet nr 15 poz.7**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, punkt 7 obłożenie okulistyczne z kieszenią po jednej stronie wyposażoną w sztywnik do regulacji, otwór wypełniony folią chirurgiczną o rozmiarze min.146x151cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną min.8x9.5cm + tampon oczny 0.4x15cm, wykonana z w strefie krytycznej z filmu PE film o grubości min.25 µm oraz z materiału w systemie SMS gramaturze min. 51 g/m<sup>2</sup>, w pozostałym obszarze wykonana tylko z materiału w systemie SMS gramaturze min.51 g/m<sup>2</sup>, odporność na przeniknie płynów w strefie krytycznej powyżej 50 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozrywanie na sucho i mokro min. 90/100 kPa.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 77 dot. pakiet nr 16**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 16, zestawu o składzie :

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm – 1 szt.
  2. ręczniki do rak min.30x35cm – 4 szt.
  3. serweta na stolik Mayo min.80x140cm – 1 szt.
  4. taśma samoprzylepna min.9x25cm – 1 szt.
  5. serwety operacyjne samoprzylepne wzmocnione 75x90cm – 2 szt.
  6. serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona min.150x200cm z paskiem lepnymin.80cm – 1 szt.
  7. serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona min.150x240cm – 1 szt.
- obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej). Gramatura laminatu podstawowego min.57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach min.20x50cm (. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109,5 g/m<sup>2</sup>
  - cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repositionowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego
  - warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania, materiał obłożenia spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych

zestaw sterylny (metoda sterylizacji – tlenek etylenu), jednorazowego użytku

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 78 dot. pakiet nr 17 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 17, punkt 1 obłożenie okulistyczne z kieszeniami po obu stronach, otwór, wypełniony folią chirurgiczną o rozmiarze 11x5/15 cm, całość serwety o rozmiarze min.151x146 cm, wykonana w strefie krytycznej z filmu PE o grubości min.25 µm oraz materiału w systemie SMS o gramaturze min.51g/cm<sup>2</sup>, w pozostałym obszarze wykonana tylko z materiału

w systemie SMS o gramaturze min.51g/cm<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej powyżej 50cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozrywanie na sucho i mokro min.81/84 kPa

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 79 dot. pakiet nr 17**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 17, fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej w systemie SMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min.(sucho/mokro)149/125 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref min. 115 N. Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej min. 115 N rękawy wykończone elastycznym, mankietem, o długości min 6 cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 80 dot. pakiet nr 17**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 17, serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach min.75x90cm o gramaturze min.23g/m<sup>2</sup>, służąca jako owinięcie zestawu

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 81 dot. pakiet nr 19 poz.3**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, punkt 3 serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym.150x200cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 82 dot. pakiet nr 19 poz.4**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, punkt 4 taśma samoprzylepna o wym.10x50cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 83 dot. pakiet nr 19 poz.5**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, punkt 5 serweta wzmocniona na stolik 150x190 – 200cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z 2-warstwowego laminatu wzmocnionego na całej powierzchni o gramaturze min. 59 g/m<sup>2</sup> wykonana z włókniny 24-30 g/m<sup>2</sup>, folia PE 28,5- 30 gr/m<sup>2</sup>, poziom absorpcji [900-981cm H<sub>2</sub>O]

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 84 dot. pakiet nr 19 poz.6**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, punkt 6 osłona na stolik Mayo 80x140cm z warstwą chłonną min.60x85cm, włóknina wiskozowa min.27 g/m<sup>2</sup>, Folia PE min. 60 µm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 85 dot. pakiet nr 19 poz.7,8**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, punkt 7,8 fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura min. 68g/m<sup>2</sup>, wstawka z przodu i na rękawach laminat– nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy PE/PP min.28 g/m<sup>2</sup>; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 211/200kPa, nieprzemakalność min. 134 mm H<sub>2</sub>O) rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 86 dot. pakiet nr 19**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, punkt ssak Yankauer 18CH. Oliwka, 27 cm zamiast 25cm , 4 otwory po bokach,, pozostałe bez zmian

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 87 dot. pakiet nr 19 poz.14**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, pozycja 14 tufery gazowy min.40x50 cm, z nitką rtg, 17 nitkowy

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 88 dot. pakiet nr 19 poz.16**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, punkt 16 diatermia – elektroda czynna z przedłużaczem min.300 cm, włączniku cięcia i koagulacji w formie dwóch guzików, kompatybilne z urządzeniem Valleylab

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 89 dot. pakiet nr 19 poz.19**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 19, punkt 19 opatrunek włókninowy min.9x30cm

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 90 dot. pakiet nr 21 poz.13**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 21, punkt 13 chusta absorbująca 50cmx70cm z wysoką absorpcją płynów, dolna warstwa nieprzepuszczalna

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 91 dot. pakiet nr 21 poz.17**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 21, punkt 17 osłona na RTG min.75x65 cm typu czepek

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 92 dot. pakiet nr 24 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 1 serweta angiograficzna z włókniny sms w rozm. min.208x330cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12cm otoczonymi folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 7-7,5cm) oraz warstwą wysokochłoną w polu zabiegowym min.. 80x120cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 68 – 70x330cm. Odległość otworów od górnej krawędzi serwety 75-80cm

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 93 dot. pakiet nr 24 poz.2**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 2 serweta absorpcyjna o wysokiej chłonności płynów z nieprzemakalną warstwą spodnią 60x60cm

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 94 dot. pakiet nr 24 poz.4**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 4 ręcznik , wysokochłonny celulozowo-poliestrowy 30x35 cm lub min. 35x45cm

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 95 dot. pakiet nr 24 poz.8**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 8 miska z tworzywa sztucznego typu nerka, niebieska min. 500ml

**Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 96 dot. pakiet nr 24 poz.13**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 13 kleszczyki metalowe proste typu Mosquito 14cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 97 dot. pakiet nr 24 poz.15**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 15 przezroczysta osłona foliowa min. 90x90cm z elastyczną krawędzią typu czepek

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 98 dot. pakiet nr 24 poz.24**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 24 worek 1 komorowy z paskiem klejącym min. 40x30cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 99 dot. pakiet nr 24 poz.25**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 25 chusta 2 warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu min. 150x170cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 100 dot. pakiet nr 24 poz.27**

Zwracamy się z prośbą doprecyzowanie w Pakiecie 24, punkt 27 Kompletu bielizny jednorazowego użytku dla operatora rozmiar L

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 101 dot. pakiet nr 25 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 25, punkt 1 chusta angiograficzna z włókniny sms w rozmiarze min. 200x300 cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 102 dot. pakiet nr 25 poz.2,3,6,7,11,16**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 25, punkt parametrów minimalnych dot. punktów 2,3,6,7,11,16

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 103 dot. pakiet nr 25 poz.14**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 25, punkt 14 – strzykawka 10 ml angiograficzna do ręcznego podawania kontrastu z męską końcówką typu luer lock  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 104 dot. pakiet nr 29 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, punkt 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 140x190cm (owinięcie zestawu)

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 105 dot. pakiet nr 29 poz.5**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, punkt 5 serweta min. 150x260 cm, przylepna

## **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 106 dot. pakiet nr 29 poz.7**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, punkt 7 ręcznik chłonny min.20x30cm celulozowo poliestrowy .

## **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 107 dot. pakiet nr 29**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, min. 2 warstwowego PP/PE pozbawione pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min.61 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów min. 900cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 150kPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.80/75 N. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie.

## **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 108 dot. pakiet nr 29 poz.9**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, punkt 9 serweta ochronna na stół operacyjny, pod pacjenta, z możliwością udźwigu pacjenta o wadze do 150 kg, (nieprzemakalne). Prześcieradło złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła min. 100 cm x 220cm . Warstwa zewnętrzna zarówno od strony pacjenta jak i od strony stołu operacyjnego wykonana z włókniny. Chłonność całkowita min. 4500ml. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny ) o wymiarze całkowitym min. 50x 180 zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się długotrwałych zabiegów operacyjnych ( przeciwoleżynow). Bielony bez użycia chloru. Wszystkie warstwy wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa.

## **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 109 dot. pakiet nr 29 poz.10**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, punkt 10 sterylne fartuch chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min.41 g/m<sup>2</sup>, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, odporność na penetrację płynów powyżej 65cm H<sub>2</sub>O na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 3,6 na całej powierzchni, wyposażony w rzep o długość min.10 cm, umożliwiający dużą regulację, ręczniki chłonne, celulozowo poliestrowe pakowane osobno

## **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 110 dot. pakiet nr 29 poz.2**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, pozycja 2 Sterylna serweta chirurgiczna 90x75cm z owalnym, przylepnym umieszczonym centralnie otworem 6x8cm

- wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min. 57g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów min. 135cm H<sub>2</sub>O wytrzymałość na rozzerwanie na sucho/mokro min. 150 kPa.

## **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 111 dot. pakiet nr 32**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 32, punkt osłona na stolik Mayo min.80x140 cm, wzmocniona na całej długości

## **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 112 dot. pakiet nr 32 poz.17,18**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 32, punkt 17,18 parametrów minimalnych

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 113 dot. pakiet nr 32 poz.21**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 32, punkt 21 serweta absorpcyjna o wymiarach min.40x48cm złożona z min. 6 warstw. wysoko absorpcyjnego laminatu o gramaturze min.60 gr/m<sup>2</sup> wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 114 dot. pakiet nr 32 poz.22**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 32, punkt 22 serweta operacyjna, laminat 2 lub 3 warstwowy min. 56 g/m<sup>2</sup> (jedną z warstw stanowi folia PE), wymiary 150x200 cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 115 dot. pakiet nr 32 poz.24**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 32, punkt 24 Wymagania:

- Materiał bazowy serwety głównej to chłonny laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup> (jedną z warstw stanowi folia PE
- Wyrób musi spełniać wymogi normy PN EN 13795, wymagania wysokie na całej powierzchni:
  - odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) >390cm H<sub>2</sub>O według PN EN 20811
  - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro (strefa krytyczna) > 160/120 kPa według PN EN ISO 13938-1
  - odporność na przenikanie cieczy min. 950 cm H<sub>2</sub>O

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 116 dot. pakiet nr 36 poz.1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 36, punkt 1 serweta do okrycia pacjenta o wymiarach min.200x350cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 117 dot. pakiet nr 36 poz.4**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 36, punkt 4 serweta absorpcyjna o dużej wchłaniałości z paskiem klejącym na dłuższym boku min.48x40cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 118 dot. pakiet nr 36 poz.6**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 36, punkt 6 min. 2 -warstwowa min.75x75cm z otworem o średnicy 9cm otoczonym polem przylepnym oraz paskiem klejącym na 1 z boków

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 119 dot. pakiet nr 36 poz.7**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 36, punkt 7 taśma przylepna operacyjna min.10x25cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 120 dot. pakiet nr 36 poz.10**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 36, punkt 10 miska typu nerka, niebieska , wykonana z tworzywa sztucznego min.500 ml

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ



**Pytanie nr 121 dot. pakiet nr 36 poz.11**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 36, punkt 11 kleszczyki naczyniowe typu Mosquito proste, wykonane ze stali nierdzewnej o dł. 14cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 122 dot. pakiet nr 36 poz.20,21**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 36, punkt 20,21, parametry minimalne

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 123 dot. pakiet nr 36 poz.22**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 36, punkt 22 serweta 2-warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu min.140x150cm

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 124 dot. pakiet nr 39**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 39, fartuch z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze min.35g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min.149/125 Kpa

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 125 dot. pakiet nr 40**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 40, zestaw o składzie :

1.serweta 75x90cm – odporność na rozciąganie na sucho/mokro min. 75/80 N, odporność na penetrację płynów min 950 cmH<sub>2</sub>O

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 126 dot. pakiet nr 24 poz.22**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 22 igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu 1.2x40mm, sterylnie zapakowana

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia , o którym mowa w zapytaniu jako równoważny.

**Pytanie nr 127 dot. pakiet nr 24 poz.23**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 24, punkt 23 igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu 0.7x40 mm, sterylnie zapakowana

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia , o którym mowa w zapytaniu jako równoważny.

**Pytanie nr 128 dot. pakiet nr 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami w niektórych składowych opisanych na czerwono jak niżej:

1. serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m<sup>2</sup>, folia PE 55 μm, poziom absorpcji [ml/100cm<sup>2</sup>]: 2,1ml – 1 szt.
2. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m<sup>2</sup>, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 μm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 μm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m<sup>2</sup>; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min 230/180kPa, nieprzemakalność min 250 mm H<sub>2</sub>O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm, rozmiar XL – 2 szt.

3. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m<sup>2</sup>, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 μm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 μm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m<sup>2</sup>; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min 230/180kPa, nieprzemakalność min 250 mm H<sub>2</sub>O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm, rozmiar L – 1 szt.
4. osłona na stolik Mayo 79x145cm (dopuszczalny wymiar +10%) z warstwą chłonną 65x85cm (dopuszczalny wymiar +10%), włóknina wiskozowa 27 g/m, Folia PE 60 μm – 1 szt.
5. ręcznik 34x53cm (dopuszczalny wymiar +10%), wysokochłonny, włókninowy – 1 szt.
6. gazik 10x10cm 17Th 12P RTG Biały – 30 szt.
7. miseczka 250ml polipropylenowa transparentna – 1 szt.
8. elektroda czynna do diatermii z ostrzem – z osłoną na ostrze, guziki w postaci „łódeczki” – przedłużenie 300cm – 1 szt.
9. nerkka 800ml polipropylenowa transparentna – 1 szt.(miska nerkowata 700 ml niebieska)
10. osłony na stopy z laminatu nieprzemakalnego, barierowego z taśmą lepną – 1 szt.
11. opatrunek oddychający, włókninowy, 9x20cm (dopuszczalny wymiar +10%) – 2 szt.(10 x 20 cm)
12. serweta 90x75cm, wykończona w centralnej części przezroczystą taśmą w systemie Flex rozmiar min 3x40cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej, rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m<sup>2</sup> łąta chłonna, włókniny 23 g/m<sup>2</sup>, folii PE – 40 μm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 2 szt. (serweta 90x75cm, wzmocniona w strefie krytycznej, z jedną taśmą lepną na dłuższym boku, chłonność 600%)
13. serweta 175x175cm, wykończona w centralnej części przezroczystą taśmą w systemie Flex rozmiar min 3x40cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m<sup>2</sup> łąta chłonna, włókniny 23 g/m<sup>2</sup>, folii PE – 40 μm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 1 szt. (serweta 180x180 cm, wzmocniona w strefie krytycznej, z jedną taśmą lepną na dłuższym boku, chłonność 600%)
14. serweta z elastyczną folią 300x175cm, wykończona w centralnej części przezroczystą taśmą w systemie Flex rozmiar min 3x40cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny 50 g/m<sup>2</sup> łąta chłonna, włókniny 23 g/m<sup>2</sup>, folii PE – 40 μm, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy powyżej 900cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 290/170 kPa – 2 szt. (serweta 240x150 cm, wzmocniona w strefie krytycznej, z jedną taśmą lepną na dłuższym boku, chłonność 600%)
15. kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24,7cm z blokadą (dopuszczalny wymiar +10%) – 1 szt. (23cm)
16. dren z końcówką typu Yankauer, z PVC T21Ch 3,0m Yank C22Ch okrągła końcówka z 4 otworami – 1 szt. (zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yank, ch24, dł. 400cm)

### Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ


### Pytanie nr 129 dot. pakiet nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O, chłonność wzmocnienia min. 680%

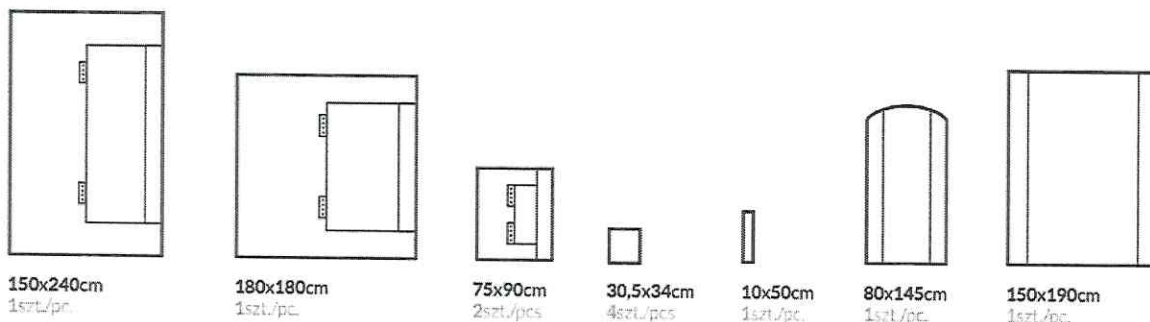

### Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 130 dot. pakiet nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami w niektórych składowych opisanych na czerwono jak niżej:

1. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200cm – 1 szt.(150 x 190 cm)
2. fartuch chirurgiczny wzmocniony wkładkami chłonnymi na rękawach oraz froncie (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów – 2 szt.
3. kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, 8 warstwowy, 17nitkowy z nitką radiacyjną – 30 szt.
4. strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-lock 20 ml – 2 szt.
5. strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-lock 10 ml – 2 szt.
6. strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-lock 5 ml – 1 szt.
7. skalpel bezpieczny n° 11 – 1 szt. (skalpel bezpieczny nr 10)
8. miska okrągła niebieska 250 ml – 1 szt.
9. miska okrągła transparentna 500 ml – 1 szt. (niebieska)
10. miska nerkowata niebieska 700 ml – 1 szt.
11. osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 100x50cm – 1 szt.(85 x 65 cm)
12. osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 90x80cm – 2 szt.(85 x 85 cm)
13. osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 120x60cm – 2 szt. (150 x 80 cm)
14. osłona na aparaturę zakończona gumką wykonana z folii PE o wymiarach 120x60cm umieszczona w osobnym sterylnym opakowaniu – 1 szt. (150 x 80 cm umieszczona w zestawie)
15. serweta absorpcyjna o wymiarach 40x48cm złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku – 1 szt. (podkład chłonny 40x60cm, waga podkładu 43g, bez taśmy samoprzylepnej)
16. rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe rozmiar 7 (para) – 1 szt.
17. rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe rozmiar 7,5 (para) – 1 szt.
18. serweta operacyjna, laminat 2 lub 3 warstwowy min 56 g/m<sup>2</sup> (jedną z warstw stanowi folia PE), wymiary 100x150cm – 1 szt.
19. serweta operacyjna, laminat 2 lub 3 warstwowy min 56 g/m<sup>2</sup> (jedną z warstw stanowi folia PE), wymiary 75x90cm z otworem samoprzylepnym 8x13cm pakowana w oddzielnie – 1 szt. (otwór 6 x 8 cm, stanowi element zestawu)
20. serweta operacyjna do zabiegów endowaskularnych o wymiarach 223x400cm, wyposażona w dwa otwory do dojścia udowego o wymiarach 16x16cm, otoczony elastyczną membraną umożliwiającą szczelne dopasowanie obłożenia Serweta wyposażona jest w warstwę chłonną o wymiarach

*[Podpis]*

100x250cm, oraz folię ochronną po obu stronach umożliwiającą łatwe dojście do paneli sterowniczych stołu operacyjnego – 1 szt.(serweta 220x320 cm wzmocniona samoprzylepna z dwoma otworami o śr. 10 cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką zabezpieczającą pulpit sterowniczy)

**21. Wymagania:**

- Materiał bazowy serwety głównej to chłonny laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> (jedną z warstw stanowi folia PE)
- Wyrób musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
- odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) >390cm H<sub>2</sub>O według PN EN 20811
- wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro (strefa krytyczna) > 310 kPa według PN EN ISO 13938-1
- Absorpcja > 550 g/m<sup>2</sup> według PN EN ISO 9073-6
- Opakowanie jednostkowe folia/ Tyvek pozwalające na otwarcie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki
- Opakowanie posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim Ułożenie poszczególnych komponentów pozwala na szybkie i bezpieczne przygotowanie do zabiegu

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 131 dot. pakiet nr 5 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, chłonność 350%?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 132 dot. pakiet nr 6 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę trzywarstwową (włóknina polipropylenowa 28g/m<sup>2</sup> + folia PE 25g/m<sup>2</sup> + polipropylen 22g/m<sup>2</sup>) w rozmiarze 80x90cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 133 dot. pakiet nr 7 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę trzywarstwową wykonaną z warstw: włóknina polipropylenowa 28g/m<sup>2</sup> + folia PE 25g/m<sup>2</sup> + polipropylen 22g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 134 dot. pakiet nr 8 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy, laminowany, wzmocniony 48-nitkami, gramatura 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 135 dot. pakiet nr 10 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 40x30cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 136 dot. pakiet nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kocyk w rozmiarze 210x110cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 137 dot. pakiet nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kocyk w rozmiarze 210x150cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 138 dot. pakiet nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kocyk ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 139 dot. pakiet nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kocyk ogrzewający jednorazowego użytku z warstwami zewnętrznymi z włókniny o gramaturze co najmniej 22g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 140 dot. pakiet nr 13 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi z przodu i na rękawach wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> (włóknina PP 25g/m<sup>2</sup> + folia PE 15g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 141 dot. pakiet nr 13 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 246,2 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź**


Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 142 dot. pakiet nr 16 poz.1**


Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O, chłonność wzmocnienia min. 680%



150x240cm  
1szt./pc.



180x180cm  
1szt./pc.



75x90cm  
2szt./pcs




30,5x34cm  
4szt./pcs



10x50cm  
1szt./pc.



80x145cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 143 dot. pakiet nr 19 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami w niektórych składowych opisanymi na czerwono jak niżej:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym. 240x150cm wyposażona w mocowanie od strony anestezyjologicznej zabezpieczające górną część obłożenia przed zsunięciem się z parawanu – 1 szt.
2. serwety boczne z taśmą lepnią z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x 75cm – 2 szt.
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym.175x175cm – 1 szt. (180 x 180 cm)
4. taśma samoprzylepna o wym.9x49cm – 1 szt. (10 x 50 cm)
5. serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m<sup>2</sup>, folia PE 55 µm, poziom absorpcji, ml/100cm<sup>2</sup>; 2,1ml – 1 szt.
6. osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa 27 g/m<sup>2</sup>, Folia PE 60 µm – 1 szt.(80 x145 cm, rozmiar wzmocnienia 60 x85cm)
7. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m<sup>2</sup>, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m<sup>2</sup>; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H<sub>2</sub>O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm, rozmiar XL – 2 szt. (fartuch wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace, szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu odporność na przenikanie cieczy 118cm H<sub>2</sub>O)
8. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych: włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m<sup>2</sup>, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna, mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa 35 µm, wstawka rękawa – nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 µm oraz włókninę wiskozowo-poliestrową 30g/m<sup>2</sup>; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H<sub>2</sub>O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm, rozmiar L – 1 szt. (fartuch wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace, szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu odporność na przenikanie cieczy 118cm H<sub>2</sub>O)
9. ostrze skalpela nr 15, grawer z nazwą producenta i numerem ostrza – 1 szt.
10. ostrze skalpela nr 22A – 1 szt.
11. gaziki 10x10 cm, 17 nitkowe, 12 warstwowe, z nitką rtg., pakowane po 10 szt – łącznie 40 szt.
12. przedłużenie do ssania (końcówek Yankauer) 30CH/21CH, dren elastyczny, giętki, ulegający łatwemu odkształceniu – 1 szt. ()
13. ssak Yankauer 18CH. Oliwka, 25 cm, 4 otwory po bokach, – 1 szt.(końcówka Yankauer CH21)
14. tufery gazowy 40x50 cm, z nitką rtg, 20 warstwowy – 5 szt. (50 x 50 cm)
15. serwety gazowe 45x45 cm, 20 nitkowa, 4 warstwowa, z nitką rtg, – 5 szt.
16. diatermia – elektroda czynna z przedłużaczem 300 cm, w plastikowym koszyczku, włączniku cięcia i koagulacji w formie dwóch guzików, kompatybilne z urządzeniem Valleylab – 1 szt.(uchwyt z elektroda z pochewką dł. Kabla 3,2 m)
17. miseczka 250 ml –1 szt.
18. kleszczyki do materiałów opatrunkowych 24,7 cm, z blokadą – 1 szt. (23 cm)
19. opatrunek włókninowy 9x35cm – 1 szt. (10 x 35 cm)
20. folia operacyjna 45x55cm – 1 szt.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 144 dot. pakiet nr 20 poz.1,składowa nr 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 220 x 320 cm z otworami o śr. 10cm bez folii, ze wzmocnieniem w rozmiarze 50x80cm, po obu stronach wyposażoną w foliowe wstawki zabezpieczające panel sterowniczy?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 145 dot. pakiet nr 20 poz.1,składowa nr 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm z przylepnym otworem o śr. 7 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 146 dot. pakiet nr 20 poz.1,składowa nr 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 147 dot. pakiet nr 20 poz.1,składowa nr 11**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 65 x 85 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 148 dot. pakiet nr 20 poz.1,składowa nr 12**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 85 x 85 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 149 dot. pakiet nr 20 poz.1,składowa nr 17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik w rozmiarze 150 x 180 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 150 dot. pakiet nr 21 poz.1,składowa nr 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 305 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 151 dot. pakiet nr 21 poz.1,składowa nr 8**

Czy Zamawiający dopuści miskę w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 152 dot. pakiet nr 21 poz.1,składowa nr 9**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 65 x 85 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 153 dot. pakiet nr 21 poz.1,składowa nr 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik w rozmiarze 160 x 220 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 154 dot. pakiet nr 21 poz.1,składowa nr 12**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 105x105cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 155 dot. pakiet nr 24 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami w niektórych składowych opisanych na czerwono jak niżej:

1. serweta angiograficzna z włókniny sms w rozm. 208x330cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12cm otoczonymi folią przylepną w świetle otworu ( $\varnothing$  samego otworu 7-7,5cm) oraz warstwą wysokochłoną w polu zabiegowym 81x120cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 68 – 70x330cm. Odległość otworów od górnej krawędzi serwety 75-80cm – 1 szt. (220x320 cm z dwoma otworami o śr. 10 cm, wzmocniona 50x80 cm. Po obu stronach wyposażona we foliowe wstawki zabezpieczające panel sterowniczy o wymiarach 60x320 cm)

2. serweta absorpcyjna o wysokiej chłonności płynów z nieprzemakalną warstwą spodnią 60x40cm – 2 szt.
3. fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem, troki złożone kartonikiem w sposób umożliwiającą samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 2 szt.
4. ręcznik papierowy wysokochłonny do rąk 35x45cm – 1 szt. (40 x 40 cm)
5. rękawice jałowe, rozmiar 7.0, hipoalergiczne – 1 szt.
6. rękawice jałowe, rozmiar 7.5, hipoalergiczne – 1 szt.
7. kompresy 10cmx10cm, 8-warstwowe – 30 szt.
8. miska z tworzywa sztucznego typu nerka, biała 500ml – 1 szt. (miska nerkowata niebieska 700 ml)
9. miska niebieska z podziałką, nieprzezroczysta 250ml – 1 szt.
10. miska przezroczysta z podziałką 500ml – 1 szt.
11. lizak do mycia pola operacyjnego dł. 15cm – 1 szt.
12. skalpel rozm.11 z przyciskiem umożliwiającym obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia. Projekt skalpela zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE – 1 szt.
13. kleszczyki metalowe proste typu Mosquito 13cm – 1 szt. (halsted mosquito zakrzywione)
14. przezroczysta osłona foliowa 85x90cm z elastyczną krawędzią typu torba – 1 szt. (typ kula, 85 x 85 cm)
15. przezroczysta osłona foliowa 90x90cm z elastyczną krawędzią typu czepek – 1 szt. (typ kula, 85 x 85 cm)
16. osłona na uchwyt do lampy – 1 szt.
17. serweta min. 2 – warstwowa 150x250cm, niebieska – 1 szt.(150 x 240 cm)
18. nakłuwacz typu spike z odpowietrzaczem – 1 szt. (przyrząd do pobierania leków z filtrem bakteryjnym)
19. strzykawka 2 częściowa z gumowym tłokiem, przezroczysta 10ml typ Luer – 2 szt.(strzykawka 3-częściowa, tłok z polipropylenu)
20. strzykawka 2 częściowa z gumowym tłokiem, przezroczysta 20ml typ Luer – 2 szt. (strzykawka 3-częściowa, tłok z polipropylenu)
21. strzykawka 2 częściowa z białym tłokiem 5ml typ Luer – 1 szt. (3-częściowa, tłok w kolorze zielonym)
22. igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu 1.2x38 mm, sterylnie zapakowana – 2 szt.(1.2 x 40 mm, bez opakowania jednostkowego)
23. igła iniekcyjna z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu 0.7x38 mm, sterylnie zapakowana – 1 szt. (0,7 x 40 mm, bez opakowania jednostkowego)
24. worek 1 komorowy z paskiem klejącym 40x35cm – 1 szt.(40 x 30 cm)
25. chusta 2 warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 150x170cm – 1 szt. (150 x 190 cm)
26. etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr kat. i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 4 szt.
27. Komplet bielizny jednorazowego użytku dla operatora rozmiar L – 1 szt.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 156 dot. pakiet nr 30 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 157 dot. pakiet nr 35 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 158 dot. pakiet nr 35 poz.1,składowa nr 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90 cm z centralnym otworem regulowanym o śr. 7cm, składającą się z dwóch części?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ



**Pytanie nr 159 dot. pakiet nr 35 poz.1,składowa nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 14cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 160 dot. pakiet nr 35 poz.1,składowa nr 3**

Czy Zamawiający dopuści nożyce proste o długości 11,5cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 161 dot. pakiet nr 35 poz.1,składowa nr 4**

Czy Zamawiający dopuści imadło o dl. 15cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 162 dot. pakiet nr 35 poz.1,składowa nr 10**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy w rozmiarze 50 x 70 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 163 dot. pakiet nr 35 poz.2,składowa nr 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporność na przenikanie płynów 180cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 164 dot. pakiet nr 35 poz.2,składowa nr 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy w rozmiarze 50 x 70 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 165 dot. pakiet nr 35 poz.3,składowa nr 1,2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporność na przenikanie płynów 180cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 166 dot. pakiet nr 35 poz.3,składowa nr 7**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy w rozmiarze 50 x 70 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 167 dot. pakiet nr 36 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami w niektórych składowych opisanych na czerwono jak niżej:

1. serweta do okrycia pacjenta wykonana z trójwarstwowej włókniny typu sms o wymiarach 240x350cm z 2 otworami o średnicy 14cm otoczonymi folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 7,5 cm) położonymi 80cm od górnej krawędzi serwety; wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłoną w rozmiarze 100x280 cm, przezroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego z obu stron obłożenia na całej jego długości o szerokości 70cm – 1 szt. (220x320 cm z dwoma przylepnymi otworami o śr. 10 cm, wzmocniona w strefie krytycznej 50 x 80 cm, wyposażona w foliowe wstawki po obu stronach zabezpieczające panel sterowniczy o wymiarach 60 x 320 cm)
2. fartuch chirurgiczny rozmiar L wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiającą samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 1 szt.
3. fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna; zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony bawełnianym mankietem dł. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiającą samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, nadruk rozmiaru na wewnętrznej stronie fartucha – 1 szt.
4. serweta absorpcyjna o dużej wchłaniałości z paskiem klejącym na dłuższym boku 48x40cm – 2 szt. (podkład chłonny 60 x 40 cm bez przylepca)

- 5.serweta 2 – warstwowa 75x90cm – 1 szt.
- 6.serweta 2 – warstwowa 75x75cm z otworem o średnicy 9cm otoczonym polem przyklepnym oraz paskiem klejącym na 1 z boków – 1 szt. (50x75cm z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7 cm)
- 7.taśma przyklepna operacyjna 10x25cm – 1 szt.
- 8.skalpel rozmiar 11 z przyciskiem umożliwiającym obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE – 1 szt.
- 9.miska okrągła, niebieska z uchwytem na prowadniki i cewniki 2500 ml – 1 szt.
- 10.miska typu nerka, biała, wykonana z tworzywa sztucznego 500 ml – 1 szt.(700 ml, niebieska)
- 11.kleszczyki naczyniowe typu Mosquito proste, wykonane ze stali nierdzewnej o dł. 13cm – 1 szt. (halstead mosquito zakrzywione, 12,5 cm)
- 12.gąbka 4x4cm na patyku do dezynfekcji pola zabiegowego dł. 15cm – 2 szt.
- 13.zaciski do chusty, czerwone o dł. 7cm – 2 szt. (chwytak plastikowy 14 cm)
- 14.strzykawka 2-częściowa typu luer o poj. 10 ml – 1 szt. (strzykawka 3-częściowa)
- 15.strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 20 ml – 2 szt. (tłok polipropylenowy)
- 16.strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 10 ml – 2 szt. (tłok polipropylenowy)
- 17.strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 5 ml – 1 szt (tłok polipropylenowy)
- 18.strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 10 ml oznaczona czerwoną naklejką z nadrukiem Nitrogliceryna – 1 szt. (bez naklejki, tłok polipropylenowy)
- 19.kompresy 8-warstwowe 7.5x7.5cm – 20 szt.
- 20.osłona foliowa ochronna na szybę typu torba z gumką o wym. 60x60cm – 1 szt. (osłona typu kula, 65 x 85 cm)
- 21.osłona foliowa ochronna typu czapka z gumką o wym. 75x80cm – 1 szt.(osłona typu kula (85 x 85 cm)
- 22.serweta 2-warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 140x150cm – 1 szt.(150 x 190 cm)
- 23.etykiety samoprzylepne umieszczone wewnątrz zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i dacie ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 4 szt.

Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier. (opakowanie torba typu tyvek)

Termin ważności zestawu min. 36 miesięcy. (24 miesiące)

Skład zestawu w języku polskim na etykiecie zewnętrznej

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 168 dot. pakiet nr 37 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami w niektórych składowych opisanymi na czerwono jak niżej:

- 1.serweta do okrycia pacjenta wykonana z trójwarstwowej włókniny typu sms o wymiarach 240x350cm z 2 otworami o średnicy 14cm otoczonymi folią przyklepną w świetle otworu (Ø samego otworu 7,5 cm) położonymi 80cm od górnej krawędzi serwety; wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłoną w rozmiarze 100x280 cm, przezroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego z obu stron obłożenia na całej jego długości o szerokości 70cm – 1 szt. (220x320 cm z dwoma przyklepnymi otworami o śr. 10 cm, wzmocniona w strefie krytycznej 50 x 80 cm, wyposażona w foliowe wstawki po obu stronach zabezpieczające panel sterowniczy o wymiarach 60 x 320 cm)
- 2.fartuch chirurgiczny rozmiar L wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiającą samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 2 szt.
- 3.fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna; zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony bawełnianym mankietem dł. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiającą samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, nadruk rozmiaru na wewnętrznej stronie fartucha – 1 szt.

- 4.serweta absorpcyjna o dużej wchłaniałości z paskiem klejącym na dłuższym boku 48x40cm – 3 szt. (podkład chłonny 60 x 40 cm bez przylepca)
- 5.serweta 2 – warstwowa 75x90cm – 1 szt.
- 6.serweta do osłonięcia krocza pacjenta 37x57cm – 1 szt.(45 x 60 cm)
- 7.skalpel rozm. 11 z przyciskiem umożliwiającym obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE
- 8.miska okrągła, niebieska z uchwytemi na przewodniki i cewniki 2500 ml – 2 szt.
- 9.miska typu nerka, niebieska z miarką 700 ml – 1 szt.
- 10.kleszczyki naczyniowe typu Mosquito proste, wykonane ze stali nierdzewnej o dł. 13cm – 1 szt.(12,5 cm)
- 11.gąbka na patyku do dezynfekcji pola zabiegowego dł. 19cm – 2 szt.
- 12.strzykawka 2-częściowa typu luer o poj. 10 ml – 2 szt. (strzykawka 3-częściowa)
- 13.strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 20 ml – 2 szt. (tłok polipropylenowy)
- 14.strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 10 ml – 2 szt. (tłok polipropylenowy)
- 15.strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock (wkręcana) 10 ml oznaczona czerwoną naklejką z nadrukiem Nitrogliceryna – 1 szt.(bez naklejki, tłok polipropylenowy)
- 16.kompresy 8-warstwowe 7.5x7.5cm – 40 szt.
- 17.igła iniekcyjna z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igłę po jej użyciu rozm. 0.8x40 mm – 2 szt.
- 18.igła iniekcyjna z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igłę po jej użyciu rozm. 0.6x38 mm – 2 szt.(0,6 x 30 mm)
- 19.osłona foliowa ochronna na szybę typu torba z gumką o wym. 100x100cm – 2 szt. (ochrona typu kula 105 x 105 cm)
- 20.osłona foliowa ochronna typu czapka z gumką o wym. 75x80cm – 1 szt. (ochrona typu kula 65x85 cm)
- 21.serweta 2-warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 150x250cm – 1 szt.(150 x 260 cm)
- 22.etykiety samoprzylepne umieszczone wewnątrz zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i dacie ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 4 szt.

Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier. (opakowanie torba typu tyvek)

Termin ważności zestawu min. 36 miesięcy. (24 miesiące)

Skład zestawu w języku polskim na etykiecie zewnętrznej.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

### **Pytanie nr 169 dot. pakiet nr 48 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami w niektórych składowych opisanych na czerwono jak niżej:

- 1.serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm serweta na stolik instrumentalny 150x190cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej serweta w kolorze niebieskim. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania warstwy serwety zgrzewane na gorąco. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym 76g/m<sup>2</sup> 63g/m<sup>2</sup> – 1 szt.
- 2.rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe rozmiar 6,5 – 1 para lateksowe
- 3.rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe rozmiar 7,0 – 1 para lateksowe
- 4.rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe rozmiar 7,5 – 1 para lateksowe
- 5.fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3x6cm i 3x13cm, mankiety o długości 8cm (+ 2cm) 7,5cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem

- Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150cm (+/- 5cm) – 2 szt. 157 cm
- 6.fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42g/m<sup>2</sup>, na rękawach 40,5g/m<sup>2</sup> Wzmocnienia o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3x6cm i 3x13cm, mankiety o długości 8cm (+ 2cm) 7,5cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość - 130cm (+/- 5cm) – 1 szt.
- 7.ręczniki 30x40cm – 4 szt. 30cm x 30cm
- 8.serweta na stolik Mayo 80x145cm 80cm x 140cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej czerwonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83g/m<sup>2</sup> 80g/m<sup>2</sup>. Wielkość wzmocnienia 75x90cm 60cm x 140cm – 2 szt.
9. torba do liczenia kompresów i tupferów, 10 kieszeniowa, foliowa – 2 szt.
- 10.osłona na uchwyt lampy – 1 szt.
- 11.butla Redona 200 ml – 1 szt.
- 12.skalpel bezpieczny ostrze 11 – 1 szt. ostrze nr 11P
- 13.kompresy z gazy 17-nitkowej 12 -warstwowych 10x20cm z nitką RTG – 50 szt.
- 14.kompresy z gazy 17-nitkowej 12 -warstwowych 10x10cm z nitką RTG – 50 szt.
- 15.kieszzeń na narzędzia 2-komorowa w rozmiarze 25x45cm 30cm x 40cm z dwoma taśmami samoprzylepnymi o szerokości 5cm służącymi do mocowania i regulacji głębokości kieszeni kieszeń z taśmą lepną 5cm x 36cm – 1 szt.
- 16.taśma samoprzylepna włókninowa 9x50cm 10cm x 50cm – 1 szt.
- 17.organizator na przewody typu rzep – 1 szt.
- 18.miska niebieska 250 ml plastikowa ze skalą – 1 szt.
- 19.tupfer gazowy z nitką RTG rozmiar 7 (wielkość pięść) – 6 szt.
- 20.tupfer gazowy z nitką RTG rozmiar 2 (orzech włoski) – 20 szt.
- 21.skalpel bezpieczny nr 10 – 1 szt.
- 22.kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego, plastikowe 24,5cm – 2 szt. 23cm
- 23.pudełko magnetyczne do zbierania i liczenia igieł duże (z gąbką) – 1 szt.
- 24.czyścik do elektrody 5x5cm – 1 szt.
- 25.bezpieczny skalpel nr. 20 – 1 szt.
- 26.jałowy, wielowarstwowy opatrunek włókninowy o znacznej chłonności, warstwa bezpośrednio przylegająca do rany wykonana z miękkiej włókniny z próżniowo naniesioną na całej powierzchni warstwą aluminium. Opatrunek z nacięciem przeznaczony np. pod dren, rozmiar 8x9cm – 1 szt. Samoprzylepny opatrunek włókninowy 9cm x 10cm z wkładem chłonnym 5cm x 6cm z przecięciem i otworem „O”
- 27.serwety RTG białe 4-warstwowe 40x40cm 45cm x 45cm (po praniu wstępny) gazowe 20-nitkowe, 4-warstwowe – 5 szt.
- 28.transparentny opatrunek pooperacyjny 10x15cm – 1 szt. 9cm x 15cm
- 29.opatrunek pooperacyjny 10x34cm – 1 szt. 10cm x 35cm
- 30.serweta samoprzylepna 75x75cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m<sup>2</sup> – 2 szt. 60 g/m<sup>2</sup>
- 31.serweta samoprzylepna 90x110cm 90cm x 120cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m<sup>2</sup> – 2 szt. 60 g/m<sup>2</sup>
- 32.samoprzylepna serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m<sup>2</sup> – 1 szt. 60 g/m<sup>2</sup>
- 33.samoprzylepna serweta 2-warstwowa Plus 150x180cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m<sup>2</sup> 60 g/m<sup>2</sup>. Serweta wzmocniona polipropylenową łąką chłonną o wymiarach (20x50cm +/- 1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąki chłonnej 109,5g/m<sup>2</sup> – 1 szt. Serweta bez wzmocnienia
34. serweta samoprzylepna 190x225cm 150cm x 240cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE. Gramatura laminatu 57,5g/m<sup>2</sup> 60 g/m<sup>2</sup> – 1 szt.

#### Odowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 170 dot. pakiet nr 49 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami w niektórych składowych opisanych na czerwono jak niżej:

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm serweta na stolik instrumentalny 150x190cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej serweta w kolorze niebieskim. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania warstwy serwety zgrzewane na gorąco. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym 76g/m<sup>2</sup> 63g/m<sup>2</sup> – 1 szt.
  2. ręczniki 30x40cm – 2 szt. 30cm x 30cm
  3. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3x6cm i 3x13cm, mankiety o długości 8cm (+2cm) 7,5cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 5cm) – 1 szt.
  4. serweta na stolik Mayo 80x145cm 80cm x 140cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej czerwonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83g/m<sup>2</sup> 80g/m<sup>2</sup>. Wielkość wzmocnienia 75x90cm 60cm x 140cm – 1 szt.
  5. miska niebieska 250 ml plastikowa ze skalą – 1 szt.
  6. tupfer z gazy 20-nitkowej 17-nitkowej rozmiar 6 (extra duży) – 5 szt.
  7. kleszczyki, plastikowe 24,5cm – 1 szt. 23 cm
  8. kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTG, owinięte banderolą po 10 szt – 20 szt.
  9. taśma samoprzylepna 9x50cm – 1 szt. 10cm x 50cm
  10. serweta 50x50cm samoprzylepna wykonana z folii – 1 szt. Folia operacyjna 55cm x 55cm (rozmiar powierzchni klejącej 51cm x 55cm)
  11. serweta ginekologiczna z torbą na płyny 240x230 cm lub 260x230cm 160/240cm x 180cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10x15cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m<sup>2</sup>. Serweta wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> Wokół pola operacyjnego polipropylenowa Łata chłonna Łata chłonna SM (spunbond, meltblown). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5g/m<sup>2</sup> 130 g/m<sup>2</sup> – 1 szt.
- Odpowiedź**  
Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 171 dot. pakiet nr 3

czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 240x150 cm – 1 szt.
- serwety boczne z taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x75 cm – 2 szt.
- serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 170x200 cm – 1 szt.
- taśma samoprzylepna 9x50 cm – 1szt.
- serwetki do rąk z włókniny kompresowej 20x40 cm – 2 szt.
- osłona na stolik Mayo 80x145 cm- 1 szt.
- serweta na stół instrum. 150x190 cm – 1 szt.

Serwety operacyjne wykonane z włókien barierowych, laminowanych, 3-warstwowych w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho w strefie krytycznej 200 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 200 kPa, odporność na przenikanie cieczy 457 cm H<sub>2</sub>O, chłonność strefy krytycznej 549%, gramatura strefy krytycznej i wzmocnienia 123 g/m<sup>2</sup>, włóknina 30 g/m<sup>2</sup>, folia PE 30 μm, warstwa chłonna włóknina polipropylenowa 63 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 172 dot. pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo o wym. 80x145 cm, warstwa chłonna 76x85 cm, wykonana z włókniny o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> i folii 70 µmm nasiąkliwość metodą run off 42,74%?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 173 dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną trójwarstwową o wym. 150x90 cm, bez taśmy lepnej, wykonaną z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 73g/m<sup>2</sup> – włóknina wiskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 174 dot. pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 73g/m<sup>2</sup> – włóknina wiskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 175 dot. pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wym. 40 x30 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 176 dot. pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną jednokomorową o wym. 42x35 cm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 177 dot. pakiet nr 12**

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta w kolorze ciemnoniebieskim?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 178 dot. pakiet nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o następujących parametrach?

- Wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, barierowej, u góry zapinany na rzep. Rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dł. min. 8cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być połączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności

- Fartuch z materiału bawełnopodobnego (włókniny celulozowo-poliestrowej). Gramatura nie mniej niż 68g/m<sup>2</sup>, wstawki – laminat 2-warstwowy polipropylenowo-polietylenowy o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozzerwania dla powierzchni krytycznych – sucho/mokro min.401/415kPa, nieprzemakalność min.224mm H<sub>2</sub>O

- Rozmiar do wyboru przez zamawiającego (M, L, XL, XXL).

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 179 dot. pakiet nr 16**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 240x150 cm – 1 szt.
- serwety boczne z taśmą lepnią z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x75 cm – 2 szt.
- serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 170x200 cm – 1 szt.
- taśma samoprzylepna 9x50 cm – 1szt.

- serwetki do rąk z włókniny kompresowej 20x40 cm – 2 szt.
- osłona na stół Mayo 80x145 cm- 1 szt.
- serweta na stół instrum. 150x190 cm – 1 szt.

obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej). Gramatura laminatu podstawowego 62 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 37,5x70 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 125 g/m<sup>2</sup>, materiał obłożenia spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych, zestaw sterylny (metoda sterylizacji – tlenek etylenu), jednorazowego użytku.

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 180 dot. pakiet nr 39**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 143,64/121,74 kPa? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 181 dot. wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt.b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 3 pkt b) zapisu na: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 182 dot. wzoru umowy § 13 ust. 1 pkt. a)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust 1 pkt a) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2.

#### **Pytanie nr 183 dot. wzoru umowy § 13 ust. 1 pkt. b)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust 1 pkt b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 184 dot. pakiet nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu uniwersalnego:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu zespolonym na całej powierzchni wzmocnienia , składana rewersowo
- 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem, przylepna
- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrościecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) laminatu 2-warstwowego o niskiej gramaturze ( max.58g/m<sup>2</sup> ) i wysokiej odporności przenikanie płynów (> 200cm H<sub>2</sub>O), na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa),o niskim współczynniku pylenia ( ≤1,9log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (absorpcja > 650 %) o gramaturze łącznej110g/cm<sup>2</sup> odporne na penetrację płynów (>200 cmH<sub>2</sub>O) oraz na rozerwanie na sucho i mokro (min.280 kPa), odporne na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N. Wcelu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z dwucentymetrowymi nieprzylepnymi końcówkami przy paskach zabezpieczających taśmy lepne nie większe niż 5cm, pozwalające wrękawicach jednych ruchem uwolnić przylepny pasek serwety do jej aplikacji.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 185 dot. pakiet nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej osłony na stolik Mayo:

Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70 $\mu$  o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95g/m<sup>2</sup>. producencie.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 186 dot. pakiet nr 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego pełnoochronnego fartucha chirurgicznego wykonanego w całości z włókniny bawełnopodobnej, barierowej, u góry zapinany na rzep. Rękawy klejone, nie szyte w miejscach krytycznych. Rękawy wykończone elastycznym dzianinowym mankietem o dł. min. 6cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności. Fartuch z materiału bawełnopodobnego (włókniny celulozowo-poliestrowej). Gramatura nie mniej niż 68g/m<sup>2</sup>, wstawka z przodu i na rękawach – bilaminat: nieprzepuszczalna folia polietylenowa z polipropylenem Spunbond o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, oddychający. Wytrzymałość na rozerwanie – sucho/mokro min.305/260kPa, nieprzemakalność min.120 cm H<sub>2</sub>O. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 187 dot. pakiet nr 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu zespolonym na całej powierzchni wzmocnienia , składana rewersowo
- 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna z włókniny Spunlance 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrościągą zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) laminatu 2-warstwowego o niskiej gramaturze ( max.58g/m<sup>2</sup> ) i wysokiej odporności przenikanie płynów (> 200cm H<sub>2</sub>O), na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa),o niskim współczynniku pylenia (  $\leq 1,9\log_{10}$ ). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (absorpcja > 650 %) o gramaturze łącznej110g/cm<sup>2</sup> odporne na penetrację płynów (>200 cmH<sub>2</sub>O) oraz na rozerwanie na suchu i mokro (min.280 kPa), odporne na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z dwucentymetrowymi nieprzylepnymi końcówkami przy paskach zabezpieczających taśmy lepne nie większe niż 5cm, pozwalające w rękawicach jednym ruchem uwolnić przylepny pasek serwety do jej aplikacji. Klej epozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 188 dot. pakiet nr 29 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycji 8,9,10,11 wchodzących w skład zestawu do portu pakowanych oddzielnie.

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia , o którym mowa w zapytaniu ale w ramach tego samego pakietu nr 29 poz.1. Zamawiający nie tworzy dodatkowego pakietu.

**Pytanie nr 189 dot. pakiet nr 33 poz.1**



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycji 4,5,6,7,8,9,10,11,12 wchodzący w skład zestawu do zabiegów laparoskopowych pakowanych oddzielnie.

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia , o którym mowa w zapytaniu ale w ramach tego samego pakietu nr 33 poz.1. Zamawiający nie tworzy dodatkowego pakietu.

**Pytanie nr 190 dot. pakiet nr 39**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 191 dot. pakiet nr 41**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego wykonanego z 71 % wiskozy, 29 % mieszaniny polimerowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 192 dot. pakiet nr 47**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycji 8,9,10,11,12,13,14,15,16 wchodzący w skład zestawu do guzków pakowanych oddzielnie.

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia , o którym mowa w zapytaniu ale w ramach tego samego pakietu nr 47. Zamawiający nie tworzy dodatkowego pakietu.

**Pytanie nr 193 dot. wzoru umowy § 4**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów” ..od dnia zgłoszenia” na „ .. od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 194 dot. wzoru umowy § 6 ust.3**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy ceny brutto w przypadku gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust.3).

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 195 dot. wzoru umowy § 13 ust.1**


Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego w wysokości:

- a) 10% kwoty brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy, wskazanej w § 9 ust. 1, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
- b) 0,2% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego (...), za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego.
- c) 0,2% wartości brutto nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego (...), w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonaniu zamówienia, nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy

### Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2.

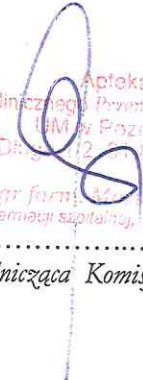  
Apteka  
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego  
UM w Poznaniu  
ul. Długa 1/2, 60-548 Poznań  
mgr farm. Marta Horowska  
specjalista farmacji szpitalnej, I\* z farmacji aptecznej  
.....  
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

*Z wyrazami szacunku*

Dyrektor Szpitala  
  
dr hab. med. Szczepan Cofa  
.....  
Dyrektor Szpitala

W załączeniu :  
Obowiązujące Pakiety nr 42,43,44,45

Oprac. Beata Zoellner



*salus aegroti, educatio, scientio*  
**SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY**  
www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl  
NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000000185  
nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



**PAKIET 42**

**Wadium: 6.815,00 zł**

Ip.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP)	Wartość bez podatku VAT Wypełnia Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada ilość sztuk w opakowaniu
	<p><b>Zestaw 23G, zestaw z kasetą do aparatu Constellation do witrekтомii w (posiadaniu Zamawiającego), w składzie:</b></p> <p><b>1.kaseta Venturii kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt.</b></p> <p><b>2.pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.</b></p> <p><b>3.oświetlacz prosty std 23G – 1 szt.</b></p> <p><b>4.linia ekstryzujna – 1 szt.</b></p> <p><b>5.zestaw trokarów 23G – 3 szt.</b></p> <p><b>6.kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.</b></p> <p><b>7.worek odpływowy – 1 szt.</b></p> <p><b>8.3-drożny zawór odcinający – 1 szt.</b></p> <p><b>9.zestaw do kroplówki – 1 szt.</b></p> <p><b>10.strzykawka 20 ml – 1 szt.</b></p> <p><b>11.igła z końcówką silikonową 23G typu Soft Tip – 1 szt.</b></p> <p><b>12.obłożenie na stolik 140x140 – 2 szt.</b></p> <p><b>13.serweta do rąk – 3 szt.</b></p> <p><b>14.mikrogąbki – 1 szt.</b></p> <p><b>15.kubeczek 60 ml – 1 szt.</b></p> <p><b>16.kubeczek 120 ml – 1 szt.</b></p> <p><b>17.strzykawka 10 ml – 1 szt.</b></p>	<p><b>400</b></p>						

<p>18.strzykawka 2 ml – 2 szt.  19.strzykawka 5 ml – 2 szt.  20.osłonka plastikowa na oko – 1 szt.  21.ocznik – 1 szt.  22.plastry – 1 szt.  23.fartuch, rozmiar L – 2 szt.  24.fartuch, rozmiar M lub równoważny rozmiar „L” – w części wierzchniej – 1 szt.  25.sączki – 1 szt.  26.obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.  27.waciki 5x5 – 10 szt.  28.igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.  29.zestaw do podawania oleju silikonowego – 1 szt.  30.oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.  31.kaniula do polewania 27G – 3 szt.  32.nożyczki jednorazowego użytku 25G lub zamiennie pęseta do ILM -1 szt. Zamawiający zdecydował w zamówieniu o zakupie nożyczek lub pęsety .  33.podłokietniki – 2 szt.  34.sonda do endolaser 23G zakrzywiona – 1 szt.</p>								
Suma								

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) .....

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) .....

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty**

**PAKIET 43**

**Wadium: 7.225,00 zł**

Ilość sztuk	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca a, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP)	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
<p><b>Przedmiot zamówienia</b></p> <p><b>Zestaw 23G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego) do fawowitrektonii 23, w składzie:</b></p> <p><b>1.kaseta Venturii kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt.</b></p> <p><b>2.pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.</b></p> <p><b>3.oświetlacz prosty std 23G – 1 szt.</b></p> <p><b>4.oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.</b></p> <p><b>5.linia ekstruzyjna – 1 szt.</b></p> <p><b>6.zestaw trokarów 23G – 1 szt.</b></p> <p><b>7.kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.</b></p> <p><b>8.worek odpływowy – 1 szt.</b></p> <p><b>9.3-drożny zawór odcinający – 1 szt.</b></p> <p><b>10.zestaw do kroplówki – 1 szt.</b></p> <p><b>11.osłona Mayo (tacy narzędziowej) – 1 szt.</b></p> <p><b>12.zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) – 1szt.</b></p> <p><b>13.strzykawka 20 ml – 1 szt.</b></p> <p><b>14.Tip skośny 30' 0,9 mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.</b></p> <p><b>15.igła z końcówką silikonową 23G typu Soft Tip – 1 szt.</b></p> <p><b>16.obłożenie na stolik 140x140 – 2 szt.</b></p> <p><b>17.serweta do rąk – 3 szt.</b></p> <p><b>18.mikrogąbki – 1 szt.</b></p>						
400						

<p>19.kubeczek 60 ml – 1 szt.  20.kubeczek 120 ml – 1 szt.  21.strzykawka 10 ml – 1 szt.  22.strzykawka 2 ml – 2 szt.  23.strzykawka 5 ml – 2 szt.  24.osłonka plastikowa na oko – 1 szt.  25.ocznik – 1 szt.  26.plastry – 1 szt.  27.fartuch, rozmiar L – 2 szt.  28.fartuch, rozmiar M – lub równoważny rozmiar „L” w części wierzchniej – 1 szt.  29.sączki – 1 szt.  30.obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i torebką – 1 szt.  31.waciki 5x5 – 10 szt.  32.igła 30G (2x igła zagięta, 1x igła prosta) – 3 szt.  33.zestaw do podawania oleju silikonowego – 1 szt.  34.nóż zakrzywiony w systemie slit 2,6 mm bevelup – 1 szt.  35.nóż skośny 15° – 1 szt.  36.nóż typu crescent 2,6mm – 1 szt.  37.oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.  38.kaniula do hydrodysekcji splaszczona 27G – 3 szt.  39.kaniula cystotom irygacyjny 27G – 1 szt.  40.pęseta jednorazowego użytku do usuwania błon ILM – 1 szt.  41.podłokietniki – 2 szt.  42.sonda do endolaseru 23G zakrzywiona – 1 szt.</p>													
<p>Suma</p>													

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) .....  
Słownie zł:  
Cena pakietu bez podatku VAT (netto) .....  
Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 44**

**Wadium: 7.225,00 zł**

Ip.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca a, który ma siedzibę na terytorium RP Cena RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia Wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP)	Wartość bez podatku VAT Wypełnia Wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
	<p>Zestaw 25+G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego) do fawowitrektonii 25+G, w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.kaseeta kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt.</li> <li>2.pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.</li> <li>3.oświetlacz prosty std 25+G – 1 szt.</li> <li>4.linia ekstruzyjna – 1 szt.</li> <li>5.zestaw trokarów 25G – 3szt.</li> <li>6.kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.</li> <li>7.worek odpływowy – 1 szt.</li> <li>8.3-drożny zawór odcinający – 1 szt.</li> <li>9.zestaw do kroplówki – 1 szt.</li> <li>10.strzykawka 20 ml – 1 szt.</li> <li>11.igła z końcówką silikonową 25G typu Soft Tip – 1 szt.</li> <li>12.obłożenie na stolik 140x140 – 2 szt.</li> <li>13.serweta do rąk – 3 szt.</li> <li>14.mikrogąbki – 1 szt.</li> <li>15.kubeczek 60 ml – 1 szt.</li> <li>16.kubeczek 120 ml – 1 szt.</li> <li>17.strzykawka 10 ml – 1 szt.</li> <li>18.strzykawka 2 ml – 2 szt.</li> <li>19.strzykawka 5 ml – 2 szt.</li> <li>20.osłonka plastikowa na oko – 1 szt.</li> </ol>	400						



<p>21.ocznik – 1 szt.  22.plastry – 1 szt.  23.fartuch, rozmiar L – 2 szt.  <b>24.fartuch, rozmiar M – lub równoważny rozmiar „L”</b>  w części wierzchniej – 1 szt.  25.sączki – 1 szt.  26.obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.  27.waciki 5x5cm – 10 szt.  28.igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.  29.kaniula do polewania 27G – 3 szt.  30.zestaw do podawania oleju silikonowego – 1 szt.  31.pęseta do ILM jednorazowego użytku 25+ – 1 szt.  32.podłokietniki – 2 szt.  33.nóż zakrzywiony typu slit 2,6mm bevelup – 1 szt.  34.nóż skośny 15' – 1 szt.  35.nóż typu crescent 2,6mm – 1 szt.  36.Tip skośny 30'0,9mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.  37.sonda do endolaseru 25G zakrzywiona – 1 szt.  38.oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.</p>											
Suma	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx						Xxxxxxx

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) .....

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT (netto) .....

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 45**

**Wadium: 7.225,00 zł**

Ilość sztuk	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca a, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłączenie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP)	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłączenie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
<p><b>Przedmiot zamówienia</b></p> <p><b>Zestaw 27+G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu Constellation (w posiadaniu Zamawiającego) do fawowitrektonii 27+G, w składzie:</b></p> <p><b>1.kaseta kompatybilna z aparatem Constellation – 1 szt.</b></p> <p><b>2.pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.</b></p> <p><b>3.oświetlacz prosty std 27+G – 1 szt.</b></p> <p><b>4.linia ekstruzyjna – 1 szt.</b></p> <p><b>5.zestaw trokarów 27G – 3szt.</b></p> <p><b>6.kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.</b></p> <p><b>7.worek odpływowy – 1 szt.</b></p> <p><b>8.3-drożny zawór odcinający – 1 szt.</b></p> <p><b>9.zestaw do kroplówki – 1 szt.</b></p> <p><b>10.strzykawka 20 ml – 1 szt.</b></p> <p><b>11.igła z końcówką silikonową 27G typu Soft Tip – 1 szt.</b></p> <p><b>12.obłożenie na stolik 140X140 – 2 szt.</b></p> <p><b>13.serveta do rąk – 3 szt.</b></p> <p><b>14.mikrogąbki – 1 szt.</b></p> <p><b>15.kubeczek 60 ml – 1 szt.</b></p> <p><b>16.kubeczek 120 ml – 1 szt.</b></p> <p><b>17.strzykawka 10 ml – 1 szt.</b></p> <p><b>18.strzykawka 2 ml – 2 szt.</b></p> <p><b>19.strzykawka 5 ml – 2 szt.</b></p> <p><b>20.osłonka plastikowa na oko – 1 szt.</b></p>						300

<p>21.ocznik – 1 szt.  22.plastry – 1 szt.  23.fartuch, rozmiar L – 2 szt.  24.fartuch, rozmiar M – lub równoważny rozmiar „L” w części wierzchniej – 1 szt.  25.sączki – 1 szt.  26.obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.  27.waciki 5x5 – 10szt.  28.igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.  29.kaniula do polewania 27G – 3 szt.  30.pęseta do ILM jednorazowego użytku 27+ – 1 szt.  31.podłokietniki – 2szt.  32.nóż zakrzywiony typu slit 2,6mm bevelup – 1 szt.  33.nóż skośny 15’ – 1 szt.  34.nóż typu crescent 2,6mm – 1 szt.  35.Tip skośny 30’0,9mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.  36.sonda do endolaser 27G zakrzywiona – 1 szt.  37.oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.</p>	XXXXX		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX
<b>Suma</b>											

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) .....

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT (netto) .....

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**