



Toruń, dnia 15 listopada 2018 r.

Nr sprawy: W.Sz.Z.: TZ – 280-111/18

**Podmioty biorące udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
wg listy adresowej**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę angiografów w ramach projektu nr RPKP.02.01.00-04.0002/17 „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1, Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela poniżej odpowiedzi:

Dotyczy Angiograf 1 – II Stół do pracowni angiograficznej punkt 6

1. Prosimy o wykreślenie zapisu punktu 6 w całości ponieważ żaden z dostępnych na rynku stołów produkowanych w systemie wymiennych blatów nie spełni obecnego wymogu. Ponadto również w punkcie 19 Zamawiający zawarł ten sam wymóg dotyczący przesuwu poprzecznego a mianowicie Zamawiający wymaga między innymi w punkcie 19:

- przesuw poprzeczny w zakresie ≥ 200 mm

Dlatego też wnioskujemy o wykreślenie zapisu punktu 6 w całości i pozostawienie zapisu punktu 19 bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2a do SIWZ dot. Angiografu nr 1 w Części II zapis punktu 6, a zapis punktu 19 pozostawia bez zmian.

Dotyczy Części VIII – Strzykawki automatyczne do angiografii i tomografii komputerowej


2. Czy Zamawiający w postępowaniu nr W.Sz.Z.: TZ-111/18 na „Dostawę angiografów” załącznik nr 2 do SIWZ dopuści strzykawki automatyczne do angiografii i tomografii komputerowej – 2 szt., tj. po 1 szt. do każdego angiografu, par. VIII pkt 2 - ekran dotykowy z menu w języku angielskim bez wyświetlanego na panelu sterującym przewodnika dla użytkownika typu „krok po kroku”??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanych strzykawek.

Dotyczy Angiograf nr 2, Stół, podpunkt 11. Wyposażenie stołu

3. Czy Zamawiający w pozycji Angiograf nr 2, w punkcie II Stół, podpunkt 11 Wyposażenie Stołu, ma na myśli podkładkę pod ramię, łokieć i przedramię pacjenta umożliwiającą wykonanie badań z dostępu radialnego, zapewniająca pełną ruchomość nadgarstka, ramienia i przedramienia pacjenta, całość wykonana z lekkiego, przeziernego włókna węglowego z elementami plastikowymi, ze zdejmowanym elementem podpierającym lewe (przeciwległe) ramię pacjenta w okolicy łokcia, dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu zabiegu pacjenta oraz odciążenia kręgosłupa operatora, wykonane z włókna węglowego z elementami plastikowymi, w zestawie dodatkowy podręczny stolik narzędziowy z regulacją, którego konstrukcja redukuje dawkę promieniowania rozproszonego na wysokości pasa i szyi, wykonany z kompozytu włókna węglowego, ołowiu oraz aluminium? Zestaw składający się z 3 elementów.

Zdjęcie poglądowe:

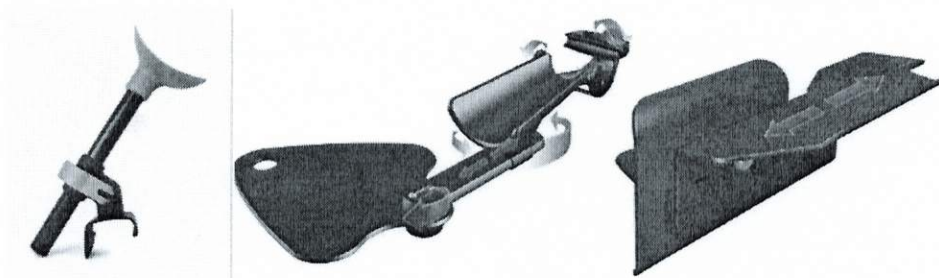

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanej podkładki.

Dotyczy załącznik nr 2a do SIWZ, par. XII, pkt. 4

4. Prosimy o wykreślenie tego zapisu, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 2a do SIWZ zapis pkt. 4 w Części XII – Szkolenie i gwarancja.

Dotyczy załącznik nr 2a do SIWZ, par. XII, pkt. 6 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ, par. 3, pkt. 2.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "czas reakcji" uwzględniał zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 2a do SIWZ, par. XII, pkt. 7 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ, par. 3, pkt. 3.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis Załącznika nr 2a do SIWZ w pkt. 7 Części XII – Szkolenie i gwarancja oraz Załącznika nr 5 do SIWZ §3 pkt 3 następująco: „Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5”.

Dotyczy Wzoru umowy.

7. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

- 1) Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

- 2) Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
- 3) Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
- 4) W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
- 5) Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
- 6) Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
- 7) Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy, Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy załącznik nr 2a do SIWZ, część IX Wyposażenie dodatkowe, punkt 5.

12. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do dostarczenia dla każdej stacji jednego monitora diagnostycznego min. 29", dostarczenie 2 monitorów diagnostycznych każdy przekątnej min, 24" i rozdzielności 2MP. Takie rozwiązanie zapewni większą elastyczność dla oceny i wyświetlania badań angiograficznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne.

Dotyczy załącznik nr 2a do SIWZ, część X, punkt 3.

13. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do dostarczenia jednego monitora diagnostycznego min. 29,8", dostarczenie 2 monitorów diagnostycznych każdy o przekątnej min, 24" i rozdzielności 2MP spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne.

Dotyczy załącznik nr 2a do SIWZ, część X, punkt 21.

14. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z niniejszej funkcjonalności, lub wprowadzenie jej jako opcjonalnej dodatkowo punktowanej. Brak zmiany zapisów w obrębie tego punktu może skutkować niemożnością złożenia przez naszą firmę ważnej oferty przetargowej i wykluczeniem z postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w Załączniku nr 2a do SIWZ w Części X pkt. 21.

Dotyczy załącznik nr 2a do SIWZ, część X, punkt 22.

15. Prosimy o dopuszczenie do postępowania urządzenia bez opisanej funkcjonalności. Brak zmiany zapisów w obrębie tego punktu może skutkować niemożnością złożenia przez naszą firmę ważnej oferty przetargowej i wykluczeniem z postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w Załączniku nr 2a do SIWZ w Części X pkt. 22.

Dotyczy załącznika nr 2a część II Stół do pracowni angiograficznej.

16. Ze względu na ograniczony do minimum czas dostarczenia systemów czy zamawiający dopuści dostarczenie opisanego stołu do 15marca 2019 r. zaś pozostałe elementy postępowania zostaną dostarczone zgodnie z terminem opisanym w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy załącznika nr 2a część V. 11.

17. Rozumiemy że zamawiający miał na myśli, iż będzie wymagał 2 monitorów w sterowni dla wyświetlania obrazów live i referencyjnegoo typu „flat” (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min. 19” z możliwością przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań co zwiększy ergonomię pracy? Wyświetlanie dwóch obrazów live w tym samym czasie jest oczywistą pomyłką i nie ma sensu aplikacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 monitorów w sterowni dla wyświetlania obrazów live i referencyjnegoo typu „flat” (TFT/LCD) o przekątnej min. 19” z lub bez możliwości (parametr oceniany) przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań.

Dotyczy załącznika nr 2a część II. 8 Stół.

18. Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu sterowania wszystkimi trybami fluoroskopii z dodatkowego wózka w Sali badań, gdyż takie rozwiązanie jest wykorzystane w salach hybrydowych ze stołami hybrydowymi. Prosimy usunąć oczywistą pomyłkę.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w Załączniku nr 2a do SIWZ w zakresie Angiografu nr 2 w Części II pkt. 8.

Dotyczy załącznika nr 2a część II. 9 Stół.

19. Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zapisu obrazów fluoroskopiowych dodatkowego wózka w Sali badań, gdyż takie rozwiązanie jest wykorzystane w salach hybrydowych ze stołami hybrydowymi. Prosimy usunąć oczywistą pomyłkę.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w Załączniku nr 2a do SIWZ w zakresie Angiografu nr 2 w Części II pkt. 9.

Dotyczy załącznika nr 2a część V. 11 Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim.

20. Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę i będzie wymagał dwóch monitorów dla obrazów live i referencyjnego w sterowni typu „flat” (TFT/LCD) o przekątnej min. 19” z lub bez możliwości przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań? Wyświetlanie dwóch obrazów live w tym samym czasie nie ma uzasadnienia aplikacyjnego.


Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch monitorów dla obrazów live i referencyjnego w sterowni typu „flat” (TFT/LCD) o przekątnej min. 19” z lub bez możliwości (parametr oceniany) przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmianie ulegają zapisy SIWZ w:

1. Załączniku nr 2/2a do SIWZ;
2. w Załączniku nr 5 do SIWZ (Wzór umowy).

Zmiany załączników w aktualnym brzmieniu (zmiany zaznaczone kolorem niebieskim oraz wykreślenia) są dostępne w zmienionej SIWZ z dnia 15.11.2018 r. opublikowanej na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. Wszelkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w TORUNIU
mgr Marcin Robaczewski