

Wrocław, 28.07.2020r.

EZP/6.12/20

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej i tętnicznej; postępowanie znak: ZP/PN/25/20/LNPPSO/JG

W związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowego postępowania Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. *zwaną dalej* ustawą) odpowiada:

Pytanie 1 Dotyczy poz. 1,2,3,4 Zestawienia asortymentowo – cenowego:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg wynikający z odpowiedzi na pyt. Nr 10, czyli: że pozycje 1,2,3,4 mają być „*pakowane sterylnie, pojedynczo (indywidualnie), gotowe do użycia*” dla zaofiarowanych igieł oraz łączników z poz. 1,2,3,4 sterylizowanych radiacyjnie, z klasą sterylności 10^{-6} , w których dla każdej pojedynczej sztuki element wymagający sterylności (ostrza igieł systemowych dwuostrzowych, końcówka luer i igła wkłuwana do korka próbówki) jest zabezpieczony indywidualną plastikową osłonką, zdejmowaną tuż przed użyciem, a tak zabezpieczone igły i łączniki pakowane są zbiorczo, w pudełku umożliwiające łatwy dostęp?

Taki sposób pakowania gwarantuje zachowanie sterylności wszystkich elementów, które jej wymagają, a jednocześnie zapewnia większą łatwość i ergonomię użycia produktów, gdyż nie wymusza dodatkowej czynności otwierania blistra.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 2 Dotyczy zestawienia asortymentowo – cenowego poz. 17:

Czy Zamawiający dokładając poz. 17 cyt: „ Uchwyt jeśli system tego wymaga” oczekuje ilości uchwytów zsumowanych z poz. 1, 2, 3 i poz. 4 a więc 299 000 jako elementu niezbędnego w trakcie pobrań systemem podciśnieniowym?

Zamawiający dodał jedynie w tej pozycji 28 000 uchwytów niezbędnych do korzystania z adaptera luer w trakcie pobrań z kaniul dożylnych, wkluc centralnych czy dojsć dotętnicznych, natomiast każda igła systemowa dwuostrzowa do pobrań wymaga uchwytu, który stanowi prowadnicę igły w trakcie punkcji i jednocześnie ułatwia podłączanie poszczególnych probówek do igły.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ilość uchwytów powinna zgadzać się z sumą z poz.1,2,3,4 co oznacza 299 000 szt. Uchwytów powinny być zintegrowane z igłą

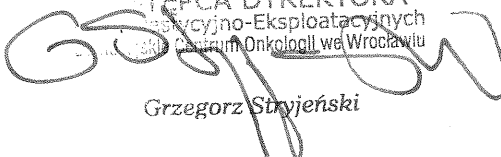
Pytanie 3 Dotyczy zestawienia asortymentowo – cenowego:

Czy Zamawiający w przypadku zaoferowania opakowań niepodzielnych przez oczekiwaną ilość sztuk wyrobów wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości w górę do pełnych opakowań (kolumna 9)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie ilości do pełnych opakowań.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający doprecyzowuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo-cenowy oraz Załącznika nr 2 - Parametry wymagane. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne na stronie Zamawiającego oraz na Platformie zakupowej.

WZMOCNIONA KOPIA
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biuro Asystyjno-Eksploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Grzegorz Stryjeński