
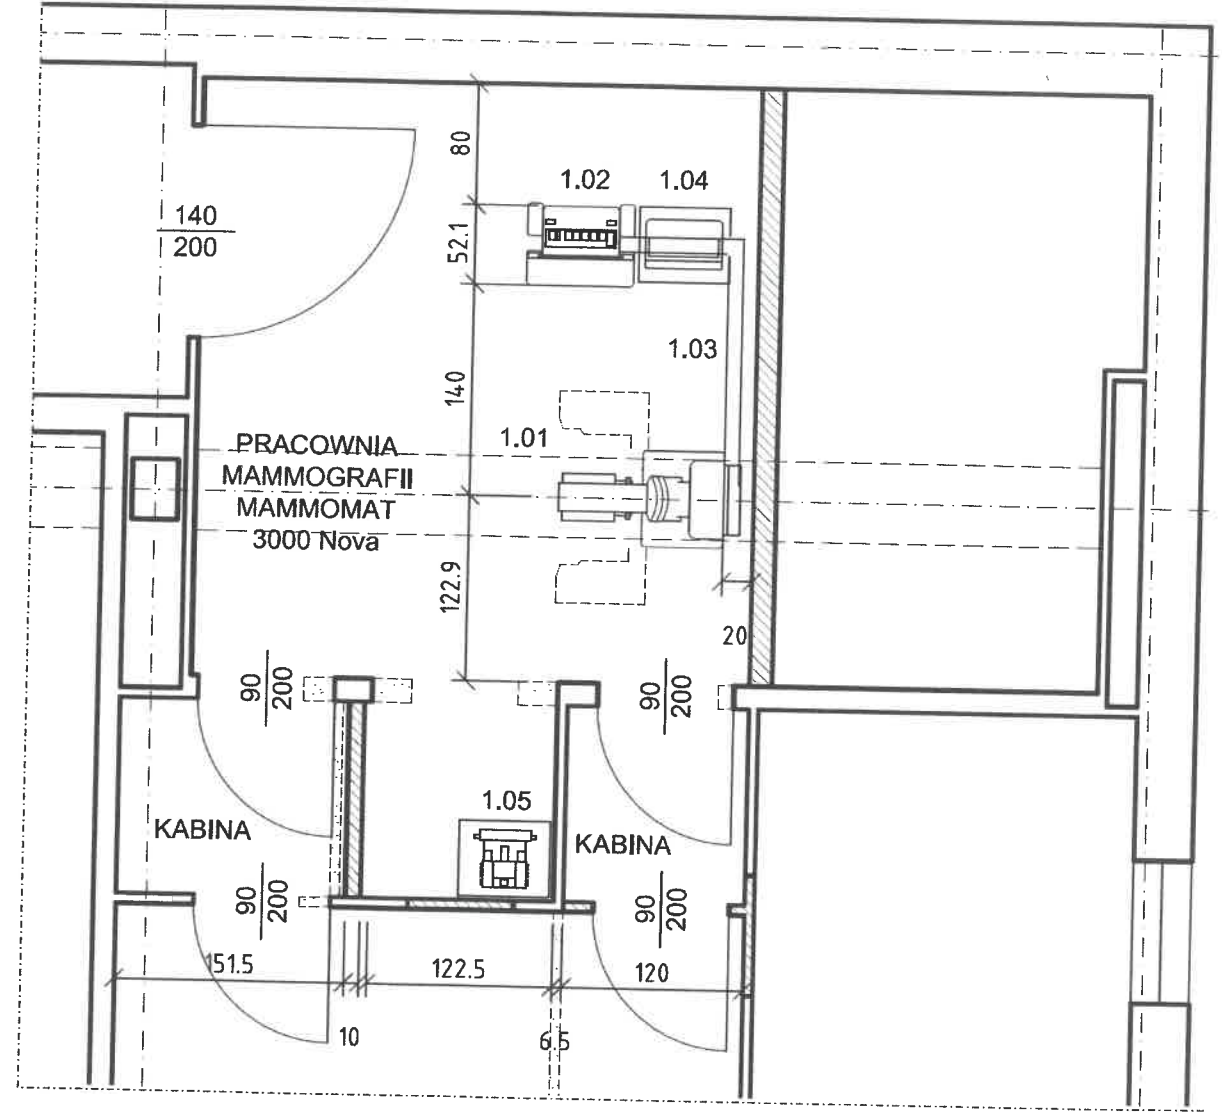


Zatwierdzenie  
 w zakresie wymagań higienicznych  
 i zdrowotnych: uzupełnienie - opinią  
 inspektor. woj. Wojewódzkiego Inspektora Sanitar-  
 nego w Bydgoszczyz dnia 04.03.2010r  
 znak: WISE.N.NZ. 401-De-2/62-1696/16

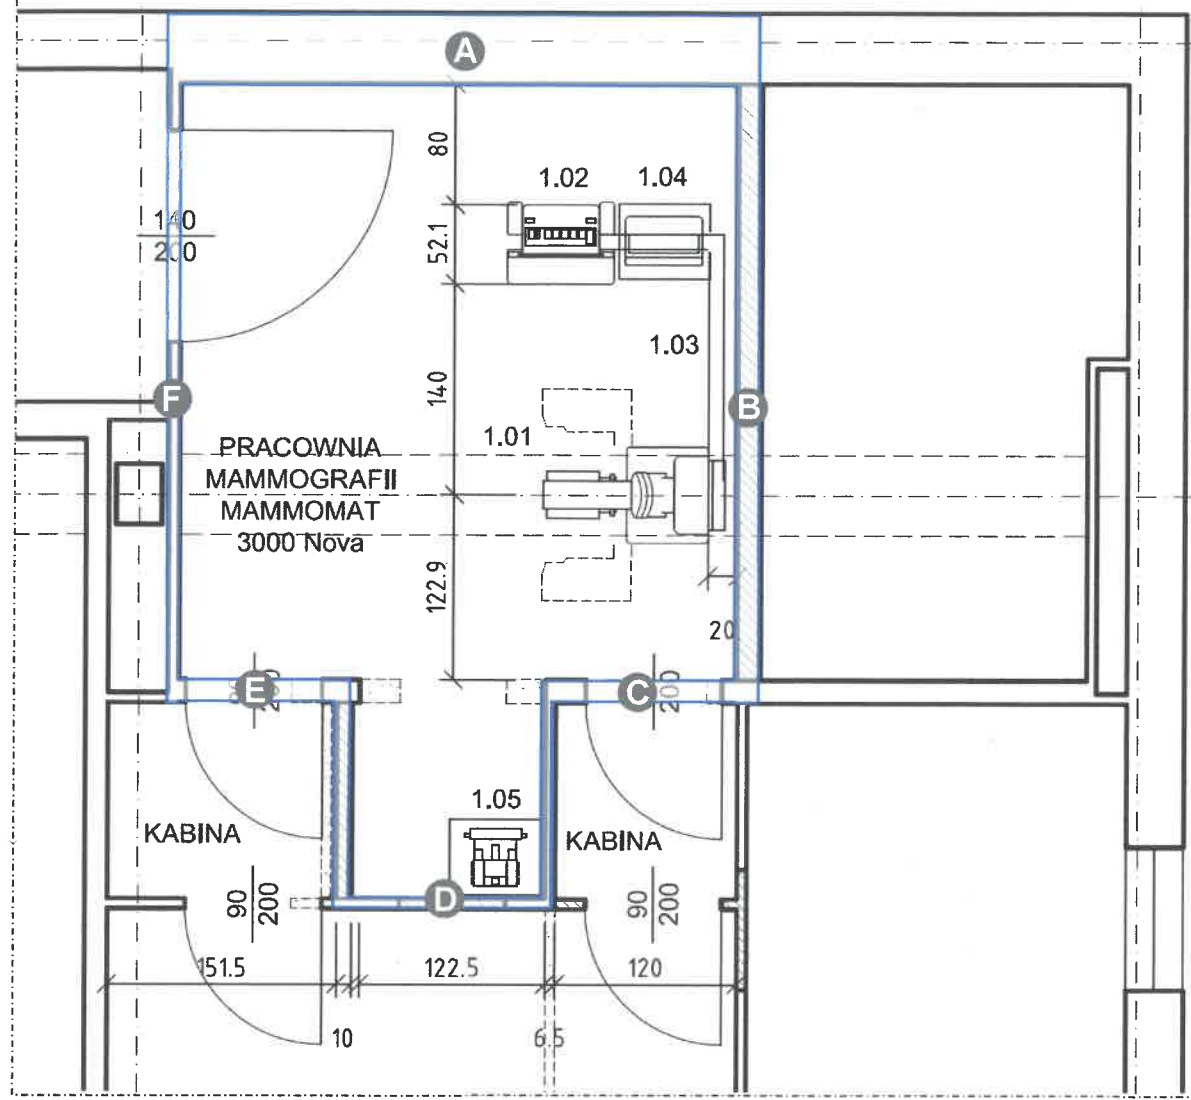

Poz.	
1.01	MAMMOMAT 3000 Nova - stojak
1.02	Generator, panel kontrolny, szyba ochronna
1.03	Napodłogowy kanał kablowy
1.04	ID kamera
1.05	Przystawka biopsyjna

	ściana projektowana
	ściana do wyburzenia
	zakres ruchu aparatu

PROJEKT OSŁON STAŁYCH		Data :listopad 2009 r.	
Nr rysunku	Skala	Oznaczenia	
2/3	1:50	osłona stała	<b>A</b>
rysunek : Fragment rzutu kondygnacji		drzwi ochronne	
Obiekt : Gabinet Mammograficzny		szyba ochronna	
Treść : <b>OSŁONY STAŁE</b>		źródło promieniowania	
Autor projektu: mgr Krystyna Bręczewska - Jankowska		kierunek wiązki pierwotnej	

PROJEKT OSŁON STAŁYCH		Data :listopad 2009 r.	
Nr rysunku	Skala	Oznaczenia	
1/3	1:50	osłona stała	<b>A</b>
rysunek : Fragment rzutu kondygnacji		drzwi ochronne	
Obiekt : Gabinet Mammograficzny		szyba ochronna	
Treść : <b>LOKALIZACJA</b>		źródło promieniowania	
Autor projektu: mgr Krystyna Bręczewska - Jankowska		kierunek wiązki pierwotnej	